

# PRODUKT KATALOG 2025



AURIKULOTHERAPIE

AURIKULOMEDIZIN

LASERTHERAPIE

LICHTTHERAPIE

AKUPUNKTUR

REFLEXZONENTHERAPIE







PRODUKT KATALOG  
**2025**



## SEDATELEC BEGLEITET DIE ENTWICKLUNG DER KOMPLEMENTÄRMEDIZIN

Sedatelec ist eine Aktiengesellschaft in vereinfachter Form, mit einem Grundkapital von 160 000 Euro, die sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von medizinischem Material spezialisiert hat.

Das Unternehmen hat seinen Standort in der Nähe von LYON, FRANKREICH, beschäftigt 20 Mitarbeiter und exportiert ca. 80 % seiner Produktion, in mehr als 40 Ländern, aus Europa und weltweit.

Das 1978 gegründete Unternehmen Sedatelec arbeitete mit Dr. Paul NOGIER (1908-1996), dem Vater der Aurikulotherapie zusammen und entwickelte die erste sterile semi-permanente Nadel für die Ohrakupunktur, die ASP®.

Das Unternehmen stellte zudem **die ersten elektronischen Geräte und Laser** für Ärzte her, die diese neue Medizintechnik praktizierten.

Dank der Entwicklung und der Diversifizierung im Bereich der Aurikulotherapie und anschließend der Aurikulomedizin, einer weiteren von Dr. Nogier entwickelten Technik, erweiterte sich der Aktivitätsbereich von Sedatelec und gewann an internationaler Bedeutung. Später erweiterte das Unternehmen seinen Markt auf die Akupunktur und allmählich auch auf andere komplementärmedizinische Verfahren (Reflexzonen-therapie, Photonotherapie®, Etiomedizin...).

### UNSERE MISSION:

- Die Entwicklung der Komplementärmedizin zu begleiten.
- Hochwertige technologische, innovative und nicht-medikamentöse Lösungen anzubieten.

### UNSERE WERTE:

-  Qualität
-  Service
-  Respekt
-  Gemeinnützigkeit
-  Professionalität
-  Zufriedene Kunden



### FINDEN SIE UNSERE QUALITÄTSZERTIFIKATE AUF UNSERER WEBSITE:

Sedatelec bemüht sich, die aktuellsten Vorschriften für Gesundheitsprodukte zu befolgen, mit dem Anliegen, stets mehr Sicherheit und Qualität für seine Produkte zu gewährleisten.

Das Qualitätsmanagementsystem von Sedatelec ist vom TÜV SÜD zertifiziert (CE 0123).



# SEDATELEC, DIE WELTREFERENZ IN DER AURIKULOTHERAPIE



## SCHNELLER SERVICE

- Bearbeitung Ihrer Bestellung am selben Tag.
- Produkte ab Lager verfügbar.
- Dynamisches Vertriebsnetzwerk in der ganzen Welt.



## BERATUNG

- Kundenberatung, Hilfe bei der Produktauswahl und Schulungen für all unsere Artikel.
- Mitteilung der Termine für Schulungen und internationale Kongresse an die Ärzte dank der Agenda Sedatelec.



## QUALITÄT

- Entwicklung, Konzeption und Herstellung in Frankreich.
- Formung, Montage und Verpackung der ASP®-Nadeln im Reinraum.
- Konformität mit der Norm ISO 13485, um eine gleichbleibende Qualität der Produkte zu garantieren und die Anforderungen im Sinne der Medizinprodukte-Sicherheitsverordnung und Rückverfolgbarkeit zu erfüllen.
- Konformität mit den EU-Vorschriften (Richtlinie 93/42 EWG).
- Produkte mit CE- oder CE 0123 Kennzeichnung.
- MDSAP Kanada und Australien Zertifizierungen, FDA für bestimmte Produkte.



## KUNDENSERVICE

- Garantie von 2 Jahren auf Herstellungsfehler (Werkstoffe und Verarbeitung).
- Reparatur Ihrer Geräte bis zu 10 Jahre nach der Einstellung der Produktion.
- Jedes reparierte Gerät durchläuft dieselben Überprüfungen wie ein Neugerät.
- Lieferung von zahlreichen Ersatzteilen, selbst älterer Baureihen.

### Ihr Ansprechpartner:



**Stefanie COCHET**

Vertriebsleiterin Export

**E-mail:** [stefaniecochet@sedatelec.com](mailto:stefaniecochet@sedatelec.com)

**Mobile:** +33 (0) 607 986 032



**Valérie Gosselin**

Export Sales

**Email :** [valeriegosselin@sedatelec.com](mailto:valeriegosselin@sedatelec.com)

**Mobile :** +33 (0) 615 046 841

Chemin des Mûriers • F - 69540 Irigny - France

**Tel.:** +33 (0) 472 663 324 • **Fax.:** +33 (0) 478 508 903

**E-mail:** [contact@sedatelec.com](mailto:contact@sedatelec.com) • **Website:** [www.sedatelec.com](http://www.sedatelec.com)

**Öffnungszeiten:** Mo-Fr 9:00 bis 12:30 Uhr und 14:00 bis 17h30 Uhr

# INHALT NACH PRODUKTEN

## SEMI-PERMANENTE NADELN

<b>ASP® Classic 8 - 80 - 200</b>	Aurikulothérapie	<b>9</b>
<b>ASP® Gold 8 - 80 - 200</b>	Aurikulothérapie	<b>9</b>
<b>ASP® Titanium 8 - 80 - 200</b>	Aurikulothérapie	<b>9</b>
<b>Klebepflaster</b>	Aurikulothérapie	<b>10</b>

## PERMANENTE NADELN

<b>ASP® Perma 8 - 80</b>	Aurikulothérapie	<b>11</b>
--------------------------	------------------	-----------

## PUNKTSUCHE & ELECTRISCHE STIMULATION

<b>Premio 20DT</b>	Aurikulothérapie, Akupunktur, Reflexzonen­thérapie	<b>14</b>
<b>Agistim Duo</b>	Aurikulothérapie, Akupunktur	<b>16</b>

## LASERSTIMULATION

<b>Premio 30 Evo</b>	Akupunktur, Aurikulothérapie	<b>20</b>
<b>Premio 32 Evo</b>	Sportmedizin, Kinesiothérapie und Aurikulothérapie	<b>23</b>
<b>Premio 32 V Evo</b>	Tier­medizin	<b>24</b>
<b>Premio 32 D</b>	Zahn­medizin	<b>25</b>

## FARB-UND LICHT-PUNKTSUCHE UND STIMULATION

<b>Premio 40 Light</b>	Aurikulomedizin	<b>28</b>
------------------------	-----------------	-----------

## WÄRMESTIMULATION

<b>Premio 10 Moxa</b>	Akupunktur	<b>32</b>
-----------------------	------------	-----------

# CONTENT BY PRODUCTS

## INSTRUMENTE & DIDAKTISCHES MATERIAL

Drucktaster	34
Multi-Drucktaster	34
Glasstäbe	34
Medizinisches Silikonohr	35
Ohrstempel	35
Patienten-erdung	35
Anzeiger für anti-tabak-behandlung, winkelmesser 30°	35
Filter 1 farbe	36
LEE Farbfrequenzprogramm	38
Scheiben für Premio 40	38
Filter: 2 übereinanderliegend Farben	39
Filter: 3 übereinanderliegend Farben	39
Filter: 3 Stern Farben	39
Andere filter	40
Leerfilter	40
Aufbewahrungsschachtel für filter	40
EASYO-sortiment	41
Endonasal-stifte	41
Wattestäbchen	41
Bildtafeln	42
Bücher	44

## ALPHABETISCHES PRODUKTVERZEICHNIS

48

## ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

50

## KLINISCHE ÜBERWACHUNG

51



## DER MASSSTAB IN DER AURIKULOTHERAPIE VON DR. PAUL NOGIER

Die ASP<sup>®</sup> Original-Dauernadel von Sedatelec wurde in Zusammenarbeit mit Dr. Paul Nogier in Frankreich entwickelt. **Seit über 40 Jahren** kommen die Nadeln täglich weltweit bei zahlreichen Praktikern, in Krankenhäusern und Schmerzkliniken zur Anwendung.

Jahrelange Forschungsarbeit und zahlreiche Verbesserungen haben dazu geführt, dass dieses Medizinprodukt, bei dem eine kleine Nadel an spezifischen Punkten der Ohrmuschel ganz präzise eingesetzt werden kann, heute ein **unvergleichbares Qualitätsniveau** erreicht hat.

### AURIKULOTHERAPIE

Die Aurikulotherapie ist eine auf der **Ohr-Somatotopie** (umgedrehter Fötus) basierende Reflexzonentherapie, die die Ohrmuschel und das zentrale Nervensystem über den Hirnstamm abgleicht.

In der Tat befinden sich im Ohr „Neurovaskuläre Komplexe“ (NVC), deren Stimulierung sehr komplexe Wirkungen zeigt und zwar nicht nur neurologischer Art, sondern auch neurosekretorischer und sogar neuroimmuner und neurovaskulärer Art.

Im Gegensatz zum weitverbreiteten Glauben ist der Ursprung der Aurikulotherapie nicht auf die Akupunktur zurückzuführen, denn sie beruht nicht auf dem Energiekonzept, das für die traditionelle chinesische Medizin so wichtig ist. Zudem ist ein Akupunkturpunkt permanent vorhanden, während **ein Punkt in der Aurikulotherapie nur dann festgestellt werden kann, wenn eine latente symptomatische Erkrankung vorliegt.**



### ✓ STÄRKEN

- Schnelle und präzise Anwendung ohne Kontaminationsgefahr
- Originelle Form, mit der eine längere Stimulierung des Ohrpunkts erreicht wird (bis zu einigen Tagen)
- Der Sedatelec-„Klick“ steht für die einwandfreie Qualität des Applikators, das Ergebnis von mehr als 40 Jahren Erfahrung
- Der Ohrpunkt kann nach dem Einsetzen der Nadel mit einem in der Einführhilfe befindlichen zweipoligen Magneten stimuliert werden (ASP Classic und Gold)
- Französische Herstellung durch Sedatelec im Reinraum, einwandfreie Qualität und ausgezeichnete Beständigkeit der Materialien
- Nadeln für den Einmalgebrauch durch Gammastrahlen sterilisiert (> 25 kGy, Haltbarkeitsdauer von 5 Jahren). CE 0123 Kennzeichnung



# ASP® ORIGINAL-NADELN: 3 METALLE ZUR AUSWAHL

## CLASSIC: NADEL AUS MEDIZINISCHEM EDELSTAHL, MIT STIMULATIONSMAGNET

Die ASP® aus Stahl entspricht der Dauernadel, die in den Anfängen der Aurikulothérapie entwickelt wurde. Das Produkt wurde im Laufe der Jahre verbessert, bleibt dabei aber den von Dr. Paul Nogier aufgestellten Kriterien treu. Medizinprodukt der Klasse IIa.



### 110614 - ASPA200 - ASP® CLASSIC 200 NADELN

17,5x11,5x5,5 cm	230 g	Verkaufseinheit: Je 10 Stück
------------------	-------	------------------------------

### 110624 - ASPA80 - ASP® CLASSIC 80 NADELN

17,5x5,5x4,5 cm	100 g	Verkaufseinheit: Je 25 Stück
-----------------	-------	------------------------------

### 110636 - ASPA8 - ASP® CLASSIC 8 NADELN

16,5x6x1 cm	25 g	Verkaufseinheit: Je 25 Stück
-------------	------	------------------------------

## GOLD: NADEL AUS MEDIZINISCHEM EDELSTAHL, GOLDBESCHICHTUNG MIT EINEM FEINGOLDGEHALT VON 99,7 %

Edelstahlnadel mit Goldbeschichtung mit einem zweipoligen Stimulationsmagneten. Die ASP® Gold wird bevorzugt bei bestimmten allergischen Patienten eingesetzt. Medizinprodukt der Klasse IIa.



### 110615 - ASPG200 - ASP® GOLD 200 NADELN

17,5x11,5x5,5 cm	230 g	Verkaufseinheit: Je 10 Stück
------------------	-------	------------------------------

### 110625 - ASPG80 - ASP® GOLD 80 NADELN

17,5x5,5x4,5 cm	100 g	Verkaufseinheit: Je 25 Stück
-----------------	-------	------------------------------

### 110637 - ASPG8 - ASP® GOLD 8 NADELN

16,5x6x1 cm	25 g	Verkaufseinheit: Je 25 Stück
-------------	------	------------------------------

## TITANIUM: NADEL AUS MEDIZINISCHEM TITAN

Nadel aus medizinischem TITAN des Reinheitsgrades 5. Diese ASP®-Nadel, die die höchste Biokompatibilität aufweist, wird bevorzugt für die Behandlung von Krankheiten verwendet, die eine Langzeitimplantation erfordern, und wird für Risikopatienten empfohlen: Diabetiker, Patienten mit Immunschwäche oder multiplen Allergien. Sie ist nicht magnetisch und kann bei einer MRT-Untersuchung somit im Ohr verbleiben. Medizinprodukt der Klasse IIa.



### 110616 - ASPT200 - ASP® TITANIUM 200 NADELN

17,5x11,5x5,5 cm	230g	Verkaufseinheit: Je 10 Stück
------------------	------	------------------------------

### 110626 - ASPT80 - ASP® TITANIUM 80 NADELN


17,5x5,5x4,5 cm	100g	Verkaufseinheit: Je 25 Stück
-----------------	------	------------------------------

### 110638 - ASPT8 - ASP® TITANIUM 8 NADELN

16,5x6x1 cm	25g	Verkaufseinheit: Je 25 Stück
-------------	-----	------------------------------

## KLEBEPFLASTER

Die im Lieferumfang der ASP Nadeln enthaltenen Klebepflaster werden aus einem mikroporösem Trägermaterial und einer hypoallergenen Klebeschicht hergestellt. Sie werden bei Bedarf eingesetzt, um den Nadelkopf zu schützen. Medizinprodukt der Klasse I.

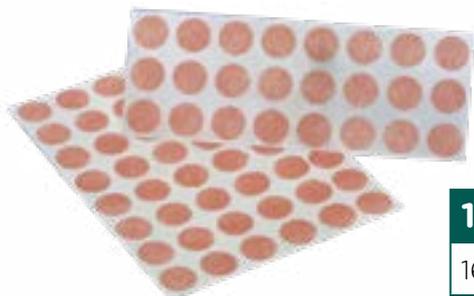

### 103621 - ASPLAST 600 - KLEBEPFLASTER 120x5

16,5x6x1 cm

25 g

1 Tüte mit 600 Klebepflaster


## HINWEISE ZUR ANWENDUNG VON ASP® ORIGINAL

1. Ohr des Patienten mit 70%igen Alkohol desinfizieren und 30 Sekunden warten, bis dieser verdunstet ist
2. Unversehrtheit des Blisters überprüfen und den Applikator aus der Verpackung nehmen
3. Spitze des Applikators auf den zu behandelnden Punkt setzen und senkrecht zur Hautoberfläche eindrücken. Das charakteristische „Klickgeräusch“ zeigt an, dass die ASP®-Nadel richtig eingesetzt ist
4. Bei Bedarf Nadel mit einem Klebepflaster abdecken
5. An der Spitze des Applikators von ASP® Classic und Gold befindet sich ein bipolarer Magnet, der speziell dazu entwickelt wurde, um die Wirkung der gesetzten Nadel regelmäßig zu stimulieren. Der mit dem Magneten versehene Applikator kann dem Patienten für eine Anwendung außerhalb der Praxis übergeben werden.
6. Für gewöhnlich fällt die Nadel nach einigen Tagen von selbst ab, sie kann aber jederzeit mit einer kleinen Pinzette entfernt werden.



# PERMANENTE NADEL FÜR DIE OHRKUPUNKTUR ASP® PERMA

Die permanente Nadel für die Ohrakupunktur ASP® Perma ist ein spezifisches Produkt für die **subkutane Implantation** einer kleinen Nadel aus TITAN. Dadurch wird eine dauerhafte Stimulation des Ohrpunkts zur Behandlung von chronischen Krankheiten und Schmerzen erzielt. Medizinprodukt der Klasse IIb.



## ✓ STÄRKEN

- Nadel aus 100% biokompatiblen medizinischem Titan
- Schnelle und präzise Anwendung ohne Kontaminationsgefahr
- Subkutane Implantation mit Applikator mit präzisen und sterilem Metallbolzen für den Einmalgebrauch
- Französische Herstellung durch Sedatelec im Reinraum, einwandfreie Qualität und ausgezeichnete Biokompatibilität im Laufe der Zeit
- Längere Stimulation ohne Einschränkung
- Da unmagnetisch, besteht kein Patientenrisiko bei einer Untersuchung unter MRT



### 11180 - ASPA80 - ASP® CLASSIC 80 NADELN

17,5x5,5x4,5 cm	100 g	Verkaufseinheit: Je 25 Stück
-----------------	-------	------------------------------

### 11181 - ASPA8 - ASP® CLASSIC 8 NADELN

16,5x6x1 cm	25 g	Verkaufseinheit: Je 25 Stück
-------------	------	------------------------------

## HINWEISE ZUR ANWENDUNG VON ASP® PERMA

Vor der Implantation einer ASP® Perma-Nadel muss der Ohrpunkt natürlich sterilisiert werden. Als einfaches und wirksames Desinfektionsmittel kann 70%iger Alkohol verwendet werden. Dabei müssen

jedoch circa 30 Sekunden abgewartet werden, bis der Alkohol verdunstet ist. Zudem erleichtert die Reinigung und Desinfektion der Ohrmuschel mit Alkohol den möglichen Einsatz eines elektrischen Detektors (Premio 20 DT, Modulo® 100) zur präzisen Bestimmung der Ohrpunkte.

Die Nadel kann durch einen kleinen chirurgischen Eingriff entfernt werden, der sehr schnell verheilt.

*Der Einsatz dieser Nadeln muss durch medizinisches Fachpersonal erfolgen, das in den Techniken der Ohrakupunktur durch Implantation geschult ist. Sie werden anstelle der wiederholten Anwendung von ASP® Original Nadeln (Classic, Gold oder Titanium, siehe Seite 8 bis 10) verwendet.*



# ELEKTRISCHE PUNKTSUCHE & STIMULATION

## PRINZIPIEN DER ELEKTRISCHEN PUNKTSUCHE



### IN ACUPUNCTURE



Dr. Niboyet konnte nachweisen, dass sich zwischen den Akupunkturpunkten und den benachbarten Bereichen ein unterschiedlicher Hautwiderstand messen lässt, der sich in einer **verringerten Impedanz** niederschlägt.

Die Akupunkturpunkte sind auf dem Körper relativ weit voneinander entfernt und das Punktsuchgerät dient dazu, die Position der Punkte präzise zu ermitteln.



### IN AURICULOTHERAPY

In der Aurikulotherapie Zur Ermittlung eines Ohrpunktes müssen die elektrischen Eigenschaften dieses **Punkts und seiner unmittelbaren Umgebung** sehr präzise **doppelt gemessen werden**. Da die Ohrpunkte zudem sehr nah beieinander liegen, können die Punkte in der Ohrmuschel nur durch die **Differentialpunktsuche** präzise und zuverlässig lokalisiert werden. Dieses Messverfahren hat Sedatelec vor vielen Jahren patentieren lassen.

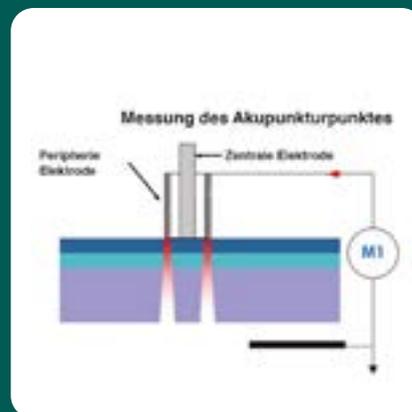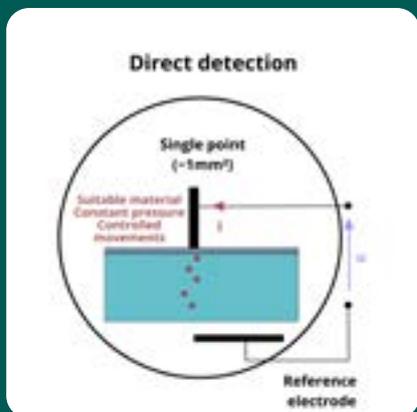

### DIE EIGENSCHAFTEN EINES GUTEN PUNKTSUCHGERÄTS:

- Ein ausreichend schwacher Messstrom, um den Punkt nicht zu stören
- Ein System der Differentialerkennung: Messung des Punktes und seiner unmittelbaren Umgebung
- Eine selbstregulierende Sensibilitätsschwelle in Abhängigkeit vom jeweiligen individuellen Hautwiderstand
- Ein Massegriff, der vom Patienten gehalten wird, um den Therapeuten aus dem Messstromkreis zu isolieren

### WIE FUNKTIONIERT EIN PUNKTSUCHGERÄT?

Das Messsystem besteht aus **drei Elektroden**: einer Referenzelektrode, die im Kontakt mit dem Patienten steht (Massegriff), und einer Sonde mit zwei koaxialen Elektroden. Die **Mittelelektrode misst den Punkt und die Peripherie-Elektrode dessen unmittelbare Umgebung**. Ein im Gerät integriertes elektronisches System verarbeitet die beiden Messungen und zeigt die Eigenschaften des Punktes in Abhängigkeit vom Unterschied der berechneten Impedanzmessung an.

# DIE ELEKTRISCHE STIMULATION

Die Elektrostimulation wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt: zum funktionellen Erhalt und zur Rehabilitation durch Muskelstimulation (NMES), zur Schmerzlinderung durch die Stimulierung von Nerven und Triggerpunkten (TENS) sowie in der klassischen Akupunktur durch die Stimulation von Körperpunkten (EA) und in der Aurikulotherapie.

Die von Sedatelec hergestellten Geräte sind Stimulatoren, die speziell für die Stimulation von Akupunkturpunkten und die Schmerzstimulation entwickelt wurden.

## DIE STIMULATIONSQUALITÄT HÄNGT VON MEHREREN FAKTOREN AB:

- Spezifische Wellenform für die Stimulation der Punkte, bereitgestellt durch einen Stromgenerator,
- Optimale Anwendungssicherheit: keine Gefahr von Hautverbrennungen,
- Eine oder mehrere Frequenzen zur effizienten Stimulation, insbesondere Verwendung der NOGIER-Frequenzen\*\*

Bei der Elektroakupunktur wird die Wirkung der Nadel durch die elektrische Stimulation verstärkt.

Die Stimulationszeit ist kürzer als bei einer Stimulation, die allein durch Nadeln erfolgt.

Die Hautelektroden können auch bei ängstlichen Patienten eingesetzt werden. Zur Schmerzbehandlung lassen sich bei einigen unserer Geräte verschiedene Frequenzwerte einstellen, wodurch eine besondere therapeutische Wirkung erzielt wird, wie zum Beispiel eine schmerzlindernde Wirkung durch die Freisetzung von Endorphinen beim Anlegen einer Niedrigfrequenz bzw. durch die segmentäre Reizhemmung beim Anlegen einer hohen Frequenz

## DIE DYNAMIK DES QI






Qi bedeutet Lebensatem, Energie und treibende Kraft. Es repräsentiert das Leben und symbolisiert die Bewegung. Diese Energie zirkuliert kontinuierlich in den Meridianen, sie ist der Ausdruck für ein Gleichgewicht zwischen Yin und Yang und ihren regelmäßigen Zyklus der Wandlung. Sie ermöglicht die harmonische Existenz des Lebewesens in seiner Individualität, das ebenso in seiner unmittelbaren Umwelt wie im gesamten Universum integriert ist. Nach der Ermittlung der Störungen und der Analyse der Ursachen durch eine gründliche und umfassende klinische Untersuchung müssen die Stellen, an denen ein Energiemangel festgestellt wurde, tonisiert werden, an Stellen mit überschüssiger Energie muss der Energiefluss sediert werden, und wenn Kreuzungspunkte gestört sind, muss der Energiefluss harmonisiert und umgeleitet werden.

## WOBBELUNG ZUR BEWAHRUNG DES QI

Die Reaktion wird durch die Impulsfrequenz beeinflusst und wenn zu lang die gleiche Frequenz angelegt wird, reagiert der Körper nicht mehr, da er gegenüber der Stimulation gleichgültig wird. Eine Stimulation ist dann wirksam, wenn sie dynamisch ist und eine Veränderung ausdrückt, so wie sich das Qi im Netzwerk der Meridiane in ständiger Bewegung befindet.

So wie das Qi in jedem Meridian größer und anschließend wieder kleiner wird, nimmt bei der Wobbelstimulation die Anzahl der pro Sekunde ausgesendeten Impulse gemäß einer komplexen mathematischen Reihe zu und wieder ab.

**Sie bezieht sich damit auf traditionelle Techniken, bei denen durch die Bewegung der Nadel in Drehrichtung bzw. in der Tiefenvariation lokal eine bestimmte Information induziert wird.**

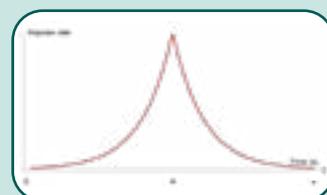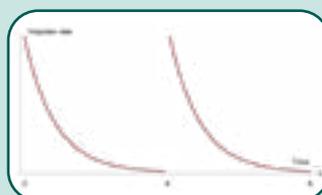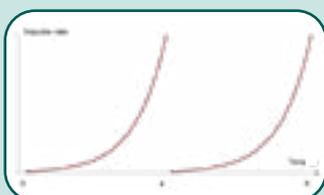

**Tonisierung, Sedierung, Harmonisierung..., die biologische Information entsteht durch Wobbelung.**

# premio 20 DT

## ELEKTRISCHE PUNKTSUCHE & STIMULATION



Elektrisches Punktsuch- und Stimulationsgerät, bahnbrechend in seiner Konzeption und auf dem neuesten Stand der Technik. Sedatelec beteiligt sich seit den Anfängen an der Entwicklung der ersten Punktsucher für die Ohrakupunktur (Diascope®, Servoscope®, Agiscop®) und konzentriert mit dem Premio 20 sein gesamtes Know-how und seine Erfahrung auf die Ausarbeitung einer neuen Gerätegeneration. Medizinprodukt der Klasse IIa.

### ✓ ADVANTAGES

- Äußerst präzise Punktsuche mit Direktablesung am Stiftdende
- Vereinfachte Anwendung durch kontinuierliche Anzeige der Detektionsänderungen
- Intuitives Gerät mit ergonomischer Tastatur und visuellen und akustischen Hilfen
- Automatische Kalibrierung der Intensität der Punktstimulation
- Sofort einsatzbereit: keine Kabel zu installieren
- Die Vom Patienten gehaltene Erdung, isoliert den Therapeuten vom Messkreis

### 111672 - PREMIO 20DT

26x20x7 cm - 450 g - Stoßsicherer Transportkoffer

Ein Transportkoffer mit:


- 1 Premio 20DT
- 1 Gebrauchsanleitung
- 1 ERT-Kappe speziell für Akupunktur
- 1 CR123A-Batterie

*Kompatibel mit handelsüblichen wiederaufladbaren CR123A-Batterien, Spannung 3,0-3,7 V, 800-1600 mAh.*



### OPTIONEN FÜR DIESES GERÄT:

A	<b>112808 Premio 20D</b> Elektrisches Punktsuchgerät
B	<b>112802 PREM-04</b> ERT Köperkappe
C	<b>113393 Premio 20DT VET</b> Veterinär-Version
D	<b>113423 PREM-011</b> Erdung für P20 DT VET

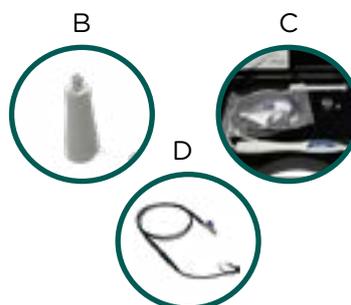



## OHRAKUPUNKTUR PUNKTUSCHE

Äußerst präziser differential-Punktsucher.

- Punktsuche mit niedriger (Gold) oder hoher (Silber) Impedanz.
- Ein Messstrom, der gering genug ist, um eine Störung des Punktes zu vermeiden.
- Visuelle und akustische Anzeige der Intensität des ermittelten Punktes (Messanzeige in 9 Stufen).



## AKUPUNKTUR PUNKTUSCHE


Direktmessung des Impedanzabfalls, mit der sanften Spitze des ERT-Ansatzstück.

- Direkt- und Sofortablesung der Messung auf dem Gerät, mit Bestätigung durch Signalton.
- Speicherung des gefundenen Punktes mit der niedrigsten Impedanz.
- Visuelle und akustische Anzeige der Intensität des ermittelten Punktes (Messanzeige in 4 Stufen).


## WIRKSAME STIMULATION

Zur Stimulation, durch einen einfachen Knopfdruck auf der Tastatur und ohne den zu behandelnden Punkt aus den Augen zu verlieren, können Sie die geeignete Stimulation auswählen:


- Durch Durchlauf der Nogier-Frequenzen\*\* (Ideal in der Aurikulothérapie)
- Durch Frequenzwobbelung: Abwechselnd zur Harmonisierung, ansteigend zwischen 1 und 100Hz zur Tonisierung, abfallend zwischen 100 und 1 Hz zur Sedierung

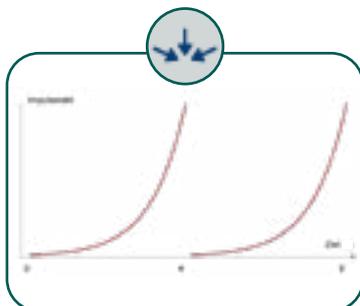

**Tonisierung**

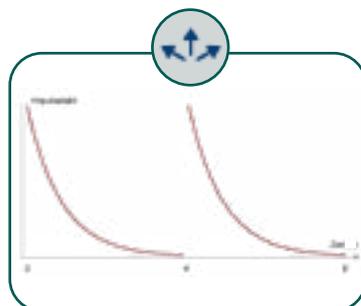

**Sedierung**

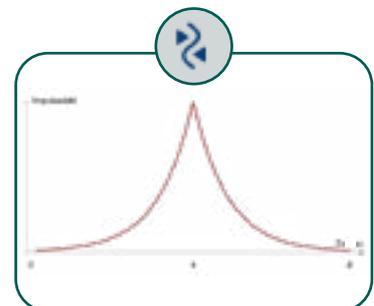

**Harmonisierung**

## DIE WOBBELFREQUENZ: DIE INNOVATION VON SEDATELEC

Sedatelec hat einen neuen Ansatz für die physiologischen Impulse entwickelt, der nicht mehr auf sich wiederholenden Frequenzen, sondern auf Dynamik, d.h. auf Beschleunigung und Verlangsamung beruht, da davon ausgegangen wird, dass der Organismus die Änderung des Signals als grundlegende Information interpretiert.

Eine Stimulation ist dann wirksam, wenn sie dynamisch ist und eine Veränderung ausdrückt, so wie sich das Qi im Netzwerk der Meridiane in ständiger Bewegung befindet.

So wie das Qi in jedem Meridian größer und anschließend wieder kleiner wird, nimmt bei der Wobbelstimulation die Anzahl der pro Sekunde ausgesendeten Impulse gemäß einer komplexen mathematischen Reihe zu und wieder ab.



# AGISTIM DUO

## ELEKTRISCHE STIMULATION



Der Agistim Duo ist ein 4-Kanal-Stimulationsgerät für die Elektroakupunktur, mit dem bis zu 16 Nadeln stimuliert werden können. Je nach gewählter Frequenz in der Elektroakupunktur zur Beschleunigung der Nadelwirkung, in der Elektrolipolyse zur Reduzierung von lokalen Lipodystrophien, in der Neurostimulation zur Stimulierung der Nervenfasern mit Elektroden und in der Schmerztherapie zur Freisetzung von Endorphinen eingesetzt zu werden. Medizinprodukt der Klasse IIa

### ✓ STÄRKEN

- 2 vollkommen unabhängige und isolierte Stromgeneratoren
- Vergoldete Stecker für einen perfekten und dauerhaften Kontakt mit den Nadeln und einer gleichzeitigen vollkommenen Isolierung der Haut
- Intensitätsanpassung auf jedem der Kanäle mit unabhängigem integriertem Sicherheitssystem.
- Statistisch kontrollierte Frequenzoszillation, um eine Gewöhnung des Körpers an die Stimulation zu vermeiden

### 108268 - AGISTIM Duo

30x25x6 cm - 1270 g - Stoßsicherer Transportkoffer

Ein Transportkoffer mit:

- 1 Agistim Duo und seine Gebrauchsanleitung
- 1 Nadelstecker Weiß/ Grau (109285 AGIDUO-011)
- 1 Nadelstecker Weiß / Rosa (109286 AGIDUO-012)
- 1 Nadelstecker Weiß / Veilchenblau ( 09287 AGIDUO-013)
- 1 Nadelstecker Weiß / Grün (109288 AGIDUO-014)
- 1 Testeinheit (109290 AGIDUO-05)
- 1 Stromversorgung 110-240 V (112378 AGIDUO-063)



#### OPTIONEN FÜR DIESES GERÄT:

A	<b>107760 AGIDUO-09</b> Styl Module
B	<b>109315 AGIDUO-031</b> 4 Nadelstecker Weiß/Grau
C	<b>109316 AGIDUO-032</b> 4 Nadelstecker Weiß/Rosa
D	<b>109317 AGIDUO-033</b> 4 Nadelstecker Weiß/ Veilchenblau
E	<b>109318 AGIDUO-034</b> 4 Nadelstecker Weiß/ Grün
F	<b>108843 AGIDUO-03</b> Kit Lipolyse « 4 Needle Module »

## WIRKSAMKEIT DER STIMULATION

- 8 verschiedenen Emissions-/Stimulationsarten
- Kontinuierliche Stimulation mit variablen Ruhezeiten
- Frequenzhub-Funktion
- Impulse: biphasisch, asymmetrisch zur Nulllinie
- Einwandfreie Stabilität der Stromstärke unabhängig von der Impedanz des Punktes
- Statistisch kontrollierte Frequenzoszillation, um eine Gewöhnung des Körpers an die Stimulation zu vermeiden
- Einstellen der Frequenz in Schritten von 0,1 Hz, bis 10 Hz, dann in Schritten von 1 Hz, bis 99 Hz



## AGISTIM DUO OPTIONEN




### STYL MODULE

Dieses Modul ermöglicht eine sehr präzise elektrische Stimulation eines Punktes ohne Nadeln oder Elektroden. Besonders nützlich an den Ohrpunkten. Möglichkeit der Behandlung mit Nogier-Frequenzen und allen Frequenzen zwischen 1 und 99 Hz.



### 4 NEEDLE MODULE

Mit diesem Modul kann die Anzahl der am AGISTIM DUO angeschlossenen Nadeln verdoppelt werden. Sehr einfaches Befestigungssystem: Befestigung der Nadel mit einer Hand durch Ziehen am Kabel.

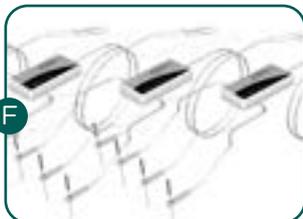

### KIT LIPOLYSE

Viermal 4-Needle-Modul Set zur Verwendung in der Akupunktur oder der Elektrolipolyse. Sie können bis zu 16 Nadeln anschließen.


Lieferung mit Gebrauchsanleitung.

## STATISTISCH KONTROLLIERTE FREQUENZSCHWINGUNG: EINZIGARTIGES KONZEPT DER FREQUENZSCHWANKUNG

Sedatelec hat ein einzigartiges Konzept der Frequenzschwankung um die für die Behandlung gewählte Referenzfrequenz erfunden: die **statistisch kontrollierte Frequenzschwungung**.

Dank eines elektronischen Steuerungssystems gibt das Agistim Duo elektrische Stimulationen ab, die sehr nahe an der für die physiologische Wirkung gewählten therapeutischen Frequenz liegen, jedoch mit einer minimalen und zufälligen Variation, die die Gewöhnung an einen Stimulationsrhythmus vermeidet.

Für den Körper ist es nie zweimal die gleiche Frequenz, er bleibt aufmerksam und reaktiv.

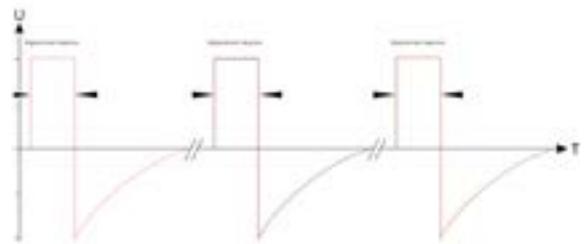

# LASERSTIMULATION



## ZWEI GROSSE ANWENDUNGSBEREICHE, DER REFLEXZONENTHERAPIE UND DER LOKALEN STIMULATION

### PUNKTSTIMULATION – FERNWIRKUNG

Der LASER wird besonders als Nadelersatz geschätzt. Die Stimulation durch LASER-Strahlen hat interessante Eigenschaften aufzuweisen:

- Sie ist **schnell**, 30 s bis 60 s, je nach Laserleistung, wenn die Lasersonde direkt auf den Punkt aufgelegt wird, um eine Streuung des Laserstrahls zu vermeiden.
- Sie ist **schmerzf**rei, was die Stimulation von Kindern und Patienten mit Angst vor den Nadeln um ein Vielfaches erleichtert.
- Sie ist von Natur aus **steril**, da keine Punktierung der Haut erfolgt.


### FLÄCHENSTIMULATION – LOKALE AKTION

Bei seinen Forschungsarbeiten testete Dr. Paul NOGIER verschiedene Frequenzkombinationen, die drei nützliche Wirkungen auslösen:

- **Schmerzlindernde Wirkung:** Behandlung von Zahnabszessen, lokalen Schmerzen, Zerrungen...
- **Geweberegenerierende Wirkung:** Beschleunigung der Wundheilung, Linderung von Aphten, Verbrennungen...
- **Muskelentspannende Wirkung:** Muskelschmerzen, Trismus etc...

### DIE LASER-BIOSTIMULATION :


- Reguliert die Emission von Nervenimpulsen: **Schmerzen und Entzündungen lassen nach**
- Stimuliert die Fibroblasten zur Steigerung der Kollagenproduktion: **beschleunigt die Vernarbung**
- Führt den Chromophoren Energie zu: **Freisetzung von ATP über die Mitochondrien, die die Proteinsynthese ermöglichen**
- Modifiziert und aktiviert Enzyme, um biologische Reaktionen einzuleiten oder aufrechtzuerhalten, die für das **reibungslose Funktionieren der Zellen** notwendig sind

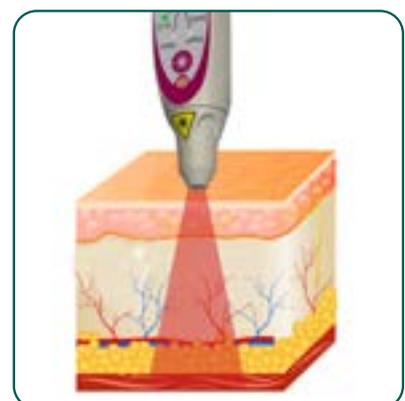

# DIE WAHL IHRES LASERGERÄTS?

## DIE WELLENLÄNGE:


Sedatelec hat sich für Laserstrahlquellen entschieden, die Laserstrahlen mit einer Wellenlänge von ca. 905 nm aussenden. In diesem Bereich wird die Strahlung vom Hämoglobin und Melanin kaum reflektiert und nur geringfügig vom Wasser absorbiert. Dadurch kann der Laserstrahl die Gewebeschichten durchdringen, ohne dass es zu einer zerstörerischen Erhitzung kommt.

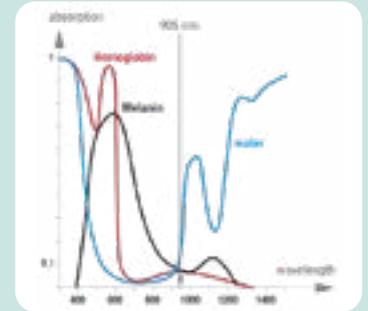

## DIE SPITZENLEISTUNG:

Dies ist die maximale Leistung, die während einer sehr kurzen Stimulationsdauer erreicht wird.


- Sie ermöglicht die Übertragung der Leistung, die zum Eindringen in tieferes Gewebe erforderlich ist.
- In Verbindung mit einer gepulsten oder supergepulsten Stimulation, mit Impulsen <100ns, keine zerstörerische thermische Wirkung.

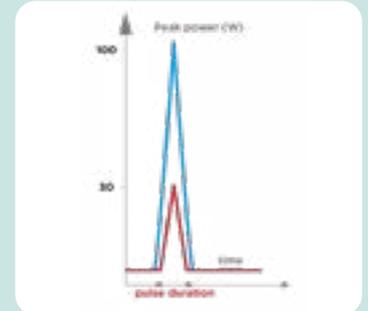

## SPEZIFISCHE LASERSTRAHLUNG:

Die Art und Weise der Laserstrahlung wirkt sich auf die Energiezufuhr zu den Zellen und auf die Dynamik der Stimulation aus.

- Moduliert : die Laserstrahlung wird nach einem festgelegten Rhythmus wiederholt unterbrochen.
- Gepulst : Laserstrahlung von sehr kurzen wiederholten Impulsen (<100 ns), mit einer großen Unterbrechung dazwischen.
- Supergepulst : Laserstrahlung von Impulsfolgen mit einer Unterbrechung, die größer ist als die Stimulationszeit.

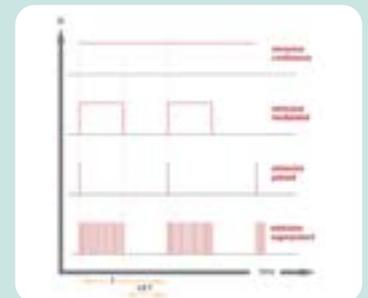

## VERWENDUNG

Der Kaltlaser ist ein sicheres, wirksames, schmerzfreies und steriles Mittel, um die biologischen Funktionen eines Organismus zu stimulieren, zu regulieren oder wieder in Gang zu bringen. Akupunktur Physiotherapie Reflexzonenmassage Veterinärmedizin Zahnheilkunde Hebammenbetreuung Schönheitsakupunktur.



Acupuncture



Physiotherapy



Reflexology



Veterinary



Odontology



Midwives



Esthetic

## DIE NOGIER-FREQUENZEN

Dr. Paul NOGIER konnte vor mehr als 20 Jahren nachweisen, dass der Organismus für Frequenzstimuli empfindlich ist und auf die jeweiligen Frequenzen unterschiedlich reagiert.

Seitdem haben auch andere Forscher die besondere Rolle von anderen Frequenzen festgestellt und bestätigt, dass die Wirksamkeit des SuperpulsLasers bei den gewählten Frequenzen den einfachen Photoneffekt der eigentlichen Laserquelle deutlich übersteigt.

Entdecken Sie die Frequenzen: siehe Seite 27.

# premio 30 evo

Laser duo



Infrarot-kalt-LASER-Stimulation der Akupunkturpunkte (einschließlich im Gesicht und an empfindlichen Stellen), der Ohrpunkte und Triggerpunkte. Medizinprodukt der Klasse IIa.

## ADVANTAGES

- **Wellenlänge 905 nm** : Zone, in der die Absorption durch Wasser und die Reflexion durch Hämoglobin und Melanin am geringsten sind.
- **Gepulste Emission** : <100 Nanosekunden Pulse, die eine geringe Energie von 0.15 oder 1.25 J / 30 Sekunden liefern, um eine thermische Erwärmung zu vermeiden.
- Sedatelec's einzigartige **Frequenzwobbelung** Stimulation zur Reproduktion des Nadeleffekts.
- Betriebsdauer von rund **7 Stunden** bei Dauerbetrieb
- **Ergonomisch**: Direktzugriff auf 4 Stimulationsprogramme

## 112048 - PREMIO 30 Evo LASER DUO

40x30x7 cm - 1200 g - Stoßsicherer transportkoffer

Ein Transportkoffer mit:

- 1 Premio 30 Evo Laser Duo
- 1 Gebrauchsanleitung
- 1 Prüfgerät für Emissionskontrolle
- 1 Schutzbrille
- 1 Schnellladegerät




### OPTIONEN FÜR DIESES GERÄT:

A	<b>113512 PREM-03-V2</b> Halterung
B	<b>113091 PREM-05</b> Körperkappe
C	<b>111032 MOD-52</b> Laserschutzbrille
D	<b>113222 PREM-03H</b> Holster für die Premio laser
E	<b>113422 PREM-010</b> Ultra-reduzierte leistungskappe

### PREMIO ADAPTER:

113129 PREM-01-EU-V2	EU
113130 PREM-01-US-V2	US
113131 PREM-01-UK-V2	UK

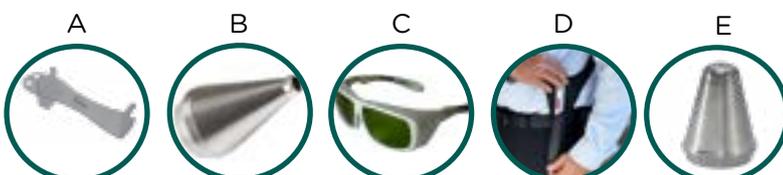

Unsichtbare Laserstrahlung.  
Do not expose eyes to the beam.  
3B classification according to  
IEC 60825-1



## AKUPUNKTUR-STIMULATION

### 3 Stimulationsarten für die Akupunktur mit Frequenzwobbelung:

- Tonisierung (100 bis 10.000 Hz)
- Sedierung (10.000 bis 100 Hz)
- Harmonisierung: Abwechslung zwischen Tonisierung und Sedierung




## AURIKULOTHERAPIE-STIMULATION


**Stimulation durch durchlauf der Nogierfrequenzen (A à G)\*\*:** Mit diesem Modus können Sie die pathologischen Punkte in der Aurikulotherapie stimulieren (Schmerzen, physiologische oder funktionelle Störungen, Suchtverhalten, ...).

## WIRKSAMKEIT DER STIMULATION


- 2 geeignete Leistungsstufen:
  - 15 W: geringe Leistung für Punkte an der Hautoberfläche (Gesicht, Ohren...)
  - 100 W: starke Leistung für tiefer gelegene Punkte (sonstige Körperpunkte)
- Sehr kurze Impulsdauer
- Niedrige Energien, die das Qi bewahren

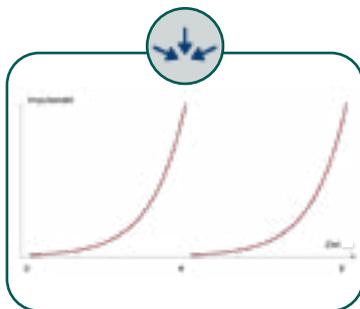

Tonisierung

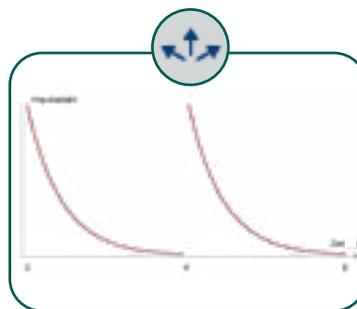

Sedierung

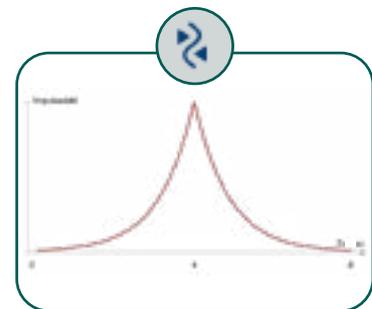

Harmonisierung

## FREQUENZWOBBELUNG: DIE INNOVATION VON SEDATELEC



Sedatelec hat einen neuen Ansatz für die physiologischen Impulse entwickelt, der nicht mehr auf sich wiederholenden Frequenzen, sondern auf Dynamik, d.h. auf Beschleunigung und Verlangsamung beruht, da davon ausgegangen wird, dass der Organismus die Änderung des Signals als grundlegende Information interpretiert.

Eine Stimulation ist dann wirksam, wenn sie dynamisch ist und eine Veränderung ausdrückt, so wie sich das Qi im Netzwerk der Meridiane in ständiger Bewegung befindet.

So wie das Qi in jedem Meridian größer und anschließend wieder kleiner wird, nimmt bei der Wobbelstimulation die Anzahl der pro Sekunde ausgesendeten Impulse gemäß einer komplexen mathematischen Reihe zu und wieder ab.



premio 32  
LASERSTIMULATION

premio 32 eva  
premio 32 v eva  
premio 32 D

## STÄRKEN

- **Wellenlänge 905nm:** Zone, in der die Absorption durch Wasser und die Reflexion durch Hämoglobin und Melanin am geringsten sind
- **Supergepulstestimulation:** mit einer sehr hohen Spitzenleistung (bis zu 100 W). Die Zellen erhalten also für eine sehr kurze Zeit (<100 ns) eine sehr hohe Leistung, um eine thermische Erwärmung zu vermeiden, und das bei einer gewählten Wiederholungsfrequenz
- **Ergonomisch:** Direktzugriff auf 4 Stimulationsprogramme und direkter Zugang zu den Nogier-Frequenzen
- Beleuchtung des Arbeitsbereichs

## DAS SEDATELEC +: DIE NOGIER-FREQUENZEN

### ANALGESIE (FREQUENZEN E UND G)

Verringert die Übertragung des Schmerzes an das zentrale Nervensystem. Die lokale Wirkung auf den Entzündungsprozess verbessert das Empfinden des Patienten und die Qualität der lokalen Reaktion.

### GEWEBEREGENERATION (FREQUENZEN A, B UND F)

Beschleunigt den Wiederaufbau des Gewebes, stellt die Zellfunktionen wieder her und beschleunigt Prozesse zur Vernarbung und Regeneration sowohl an der Oberfläche wie in der Tiefe.

### MUSKELENTSPANNUNG (FREQUENZEN C, D UND G)

Fördert die Lockerung von Verspannungen und Verhärtungen..

### DURCHLAUF DER NOGIER-FREQUENZEN\*\*

Bei diesem Programm werden alle pathologischen Bereiche stimuliert, ganz gleich welchen Ursprungs sie sind (Schmerzen, physiologische oder funktionelle Störungen, Suchtverhalten...). Es ermöglicht die aufeinanderfolgende Emission aller Nogier-Frequenzen per Frequenzdurchlauf (Frequenzen A, B, C, D, E, F und G).

### INDIVIDUELLE AUSWAHL DER NOGIER-FREQUENZEN

Alle 7 Nogier-Frequenzen können individuell ausgewählt werden, um eine Wirkung auf eine ganz bestimmte physiologische Funktion zu erzielen.



# premio 32 evo

Laser A-G program



**NEU!**  
Effiziente,  
Schnelle,  
Tiefenwirksame  
Stimulation

Universal-Soft-Laser zur Biostimulation. Er eignet sich zur Punkt- und Flächenanwendung. Es liefert eine schmerzlindernde und regenerierende, lokale, schnelle und intensive Wirkung, ohne Nebenwirkungen. Medizinprodukt der Klasse IIa.

## ✓ ADVANTAGES

- **Spitzenleistung von 100 Watt**, um bis in die tiefen Gewebe einzudringen
- Konstante Energie von **5 J/Min** dank des Supergepulsten Emissionsmodus
- Spezielle ERP-Leistungsreduzierende-Kappe für die Ohrakupunktur oder das Gesicht

### 112049 - PREMIO 32 Evo LASER A-G PROGRAM

40x30x7 cm - 1200 g - Stoßsicherer Transportkoffer

Ein Transportkoffer mit:

- 1 Premio 32 Evo Laser A-G Program
- 1 Gebrauchsanleitung
- 1 Prüfgerät für Emissionskontrolle
- 1 Laserschutzbrille
- 1 Schnellladegerät
- 1 ERP - Leistungsreduzierende-Kappe




#### OPTIONEN FÜR DIESES GERÄT:

A	<b>113512 PREM-03-V2</b> Halterung
B	<b>113091 PREM-05</b> Körperkappe
C	<b>111032 MOD-52</b> Laserschutzbrille
D	<b>113222 PREM-03H</b> Holster für die Premio laser
E	<b>113422 PREM-010</b> Ultra-reduzierte leistungskappe

#### PREMIO ADAPTER:

113129 PREM-01-EU-V2	EU
113130 PREM-01-US-V2	US
113131 PREM-01-UK-V2	UK

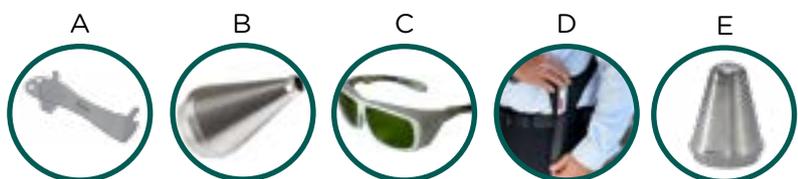

*Unsichtbare Laserstrahlung.  
Do not expose eyes to the beam.  
3B classification according to  
IEC 60825-1*

# premio 32 v evo

## LASER STIMULATION FOR VETS



Biostimulation-Soft-Laser für die Tierarztpraxis, das eine schmerzlindernde, regenerierende, entspannende, lokale, schnelle und intensive Wirkung, ohne Nebenwirkungen liefert.

Medizinprodukt der Klasse IIa.

### ✓ STÄRKEN

- **Spitzenleistung von 100 Watt**, um bis in die tiefen Gewebe einzudringen
- Konstante Energie von **5 J/Min** dank des Supergepulsten Emissionsmodus
- **Aufsätze aus verstärktem Spezialstahl**, die die Laserdiode von der abrasiven Wirkung der Tierhaut schützen
- Spezielle Frequenzen, um die Wiederherstellung der Zellfunktionen (Gingivitis bei Katzen), den Wiederaufbau von Gewebe sowie die Heilungsprozesse besser zu berücksichtigen

### 113252 - PREMIO 32 V EVO LASER

40x30x7 cm - 1200 g - Stoßsicherer Transportkoffer

Ein Transportkoffer mit:

- 1 Premio 32 EVO Laser A-G Program
- 1 Gebrauchsanleitung
- 1 Prüfgerät für Emissionskontrolle
- 2 verstärkte Stahlaufsätze (112471 PREM-02)
- 1 Laserschutzbrille (111032 MOD-52)
- 1 Schnellladegerät
- 1 ERP - Leistungsreduzierende-Kappe




### OPTIONEN FÜR DIESES GERÄT:

A	<b>113512 PREM-03-V2</b> Halterung
B	<b>113091 PREM-05</b> Köperkappe
C	<b>111032 MOD-52</b> Laserschutzbrille
D	<b>113222 PREM-03H</b> Holster für die Premio laser
E	<b>113422 PREM-010</b> Ultra-reduzierte leistungskappe

### PREMIO ADAPTER:

113129 PREM-01-EU-V2	EU
113130 PREM-01-US-V2	US
113131 PREM-01-UK-V2	UK

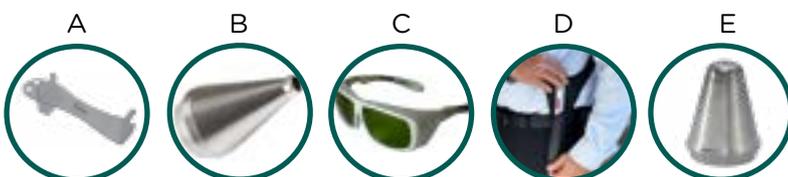

*Unsichtbare Laserstrahlung.  
Do not expose eyes to the beam.  
3B classification according to  
IEC 60825-1*

# premio 32 D evo

## STIMULATION LASER DENTAIRE



Biostimulation-Soft-Laser, dass eine schmerzlindernde, regenerierende, entspannende, lokale, schnelle und intensive Wirkung, ohne Nebenwirkungen liefert und die Förderung der Hämostase ermöglicht. Medizinprodukt der Klasse IIa.

### ✓ STÄRKEN

- **Spitzenleistung von 75 W**, um besser in die Gewebe einzudringen
- Konstante Energie von **1,2 J oder 1,8 J/min** dank des Supergepulsten Emissionsmodus
- Präzise Anwendung im Mund mit der **gebogenen Glasfaser**
- Spezielle Frequenzen, die auf die Erzeugung von Knochenkeilen, auf Muskelkontraktionen (Trismus) und auf die Narben- und Algenfolgen von Zahnabsprüngen wirken.

### 112685 - PREMIO 32 D EVO LASER

40x30x7 cm - 1200 g - Stoßsicherer Transportkoffer

Ein Transportkoffer mit:

- 1 Premio 32D EVO Laser
- 1 Gebrauchsanleitung
- 2 optische Fasern
- 1 Zahnschlüssel
- 1 Körperschlüssel
- 1 Prüfgerät für Emissionskontrolle
- 1 Laserschutzbrille
- 1 Schnellladegerät



### OPTIONEN FÜR DIESES GERÄT:

A	<b>113512 PREM-03-V2</b> Premio Halterung
B	<b>111032 MOD-52</b> Laserschutzbrille

### PREMIO ADAPTER:

113129 PREM-01-EU-V2	EU
113130 PREM-01-US-V2	US
113131 PREM-01-UK-V2	UK



Unsichtbare Laserstrahlung.  
Den Laserstrahl nicht auf die Augen richten.  
Klassifizierung 3B nach IEC 60825-1

# PUNKTSUCHE UND FARBSTIMULATION

## AURIKULOMEDIZIN & PHOTONOTHERAPIE®



### AURIKULOMEDIZIN

Paul Nogier stellte 1966 zufällig fest, dass er bei leichtem Druck auf das Ohr eine Abnahme oder Zunahme des Radialispulses beobachtete. Der Rhythmus änderte sich nicht, aber es schien, dass der Radialispuls stärker oder schwächer wurde.

Nachdem er dieses Phänomen bei zahlreichen Patienten untersucht hatte, nannte er es den Aurikulokardialen Reflex (**RAC**). Mit zunehmender Erfahrung näherte man sich der Möglichkeit der Existenz eines allgemeineren Phänomens an, das auf Anraten von Professor Pierre MAGNIN (Besançon) **VAS** genannt wurde: Vascular Autonomic Signal. Anders ausgedrückt, das autonome Gefäßsignal.

Bei jedem Menschen „verhärtet“ sich der Radialispuls, wenn man seine Haut mit einem Lichtblitz beleuchtet. Dieses Phänomen dauert im Allgemeinen drei Pulsschläge und gibt eine Anpassung des Organismus an eine neue elektromagnetische Situation wieder.

Gemäß der Arbeit von Paul NOGIER kann die Hautstimulation, die das VAS auslösen kann, mechanisch oder durch Licht erfolgen. In der Aurikulomedizin werden mithilfe der Messung des Radialispulses hauptsächlich die Antworten des Organismus auf Hautstimulierungen bewertet. Die Reaktionen sind gut bekannt und die Untersuchungen wurden standardisiert. Dadurch ist es möglich, bei einigen Patienten anormale Reaktionen aufzuspüren, die im Allgemeinen mit der Aurikulotherapie zu behandeln sind. Die Aurikulomedizin ist derzeit noch eine marginale Technik, die es erlaubt, beneidenswerte therapeutische Ergebnisse zu erzielen. Sie steht an der Spitze der klinischen Forschung und wird zweifelsohne der Ursprung für die größten Errungenschaften der Physiologie von morgen sein.

**Die intermittierende Lichtstimulation der Haut kann eine Anzahl an sehr verschiedenen RAC hervorrufen, je nachdem, welche Frequenz für die Lichtimpulse gewählt wurde. Dies stellt einen grundlegenden Teil der Aurikulomedizin dar.**

### PHOTONOTHERAPIE®

Eine neue, von Professor Magnin entwickelte Therapie, basierend auf den Entdeckungen der Aurikulomedizin: Nogier-Puls und Lichtwahrnehmung. Diese lichtbasierte Behandlung ist die Modulation der Photonenemission über farbige Scheiben, die durch eine entsprechende Beleuchtung aktiviert werden: Dies ist die Quintessenz der Photonotherapie®.


Es handelt sich um eine authentische Methode, die auf der energetischen und funktionellen Neuordnung der Elektronenaktivität basiert. Sie kombiniert Farbscheiben und Nogier-Frequenzen\*\*.

# PRÄSENTATION DER NOGIER-FREQUENZEN\*\*

Die Körperorgane haben einen rhythmischen Stoffwechsel. In den 70er Jahren entdeckte Paul Nogier bei der Anwendung des RAC eine physiologische Übereinstimmung eines Frequenzbereiches mit den verschiedenen Teilen der Hautdecke.

Die Haut enthält verschiedene Arten von Sinnesrezeptoren und Sensoren, durch die sie empfänglich für verschiedene Stimuli ist, wie zum Beispiel für elektromagnetische Stimulationen mit verschiedenen Wellenlängen.

Bei der Hautstimulierung mithilfe eines Diodenlichts und Hertz-genaue Einstellungen entdeckte er, dass einige Bereiche der Ohrmuschel und des Körpers auf bestimmte Frequenzen gleich reagieren:

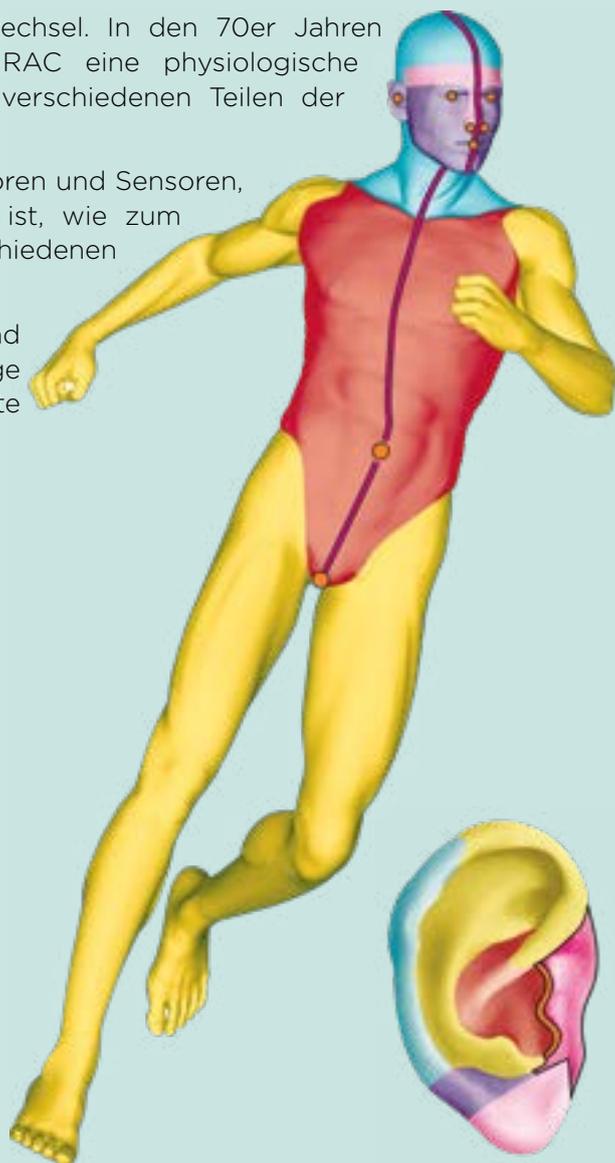

**A 2,28 Hz, Orange 21**, Basis-Areal, repräsentiert den Anabolismus

- Stimulation der Zellenarbeit
- Entzündungshemmende Wirkung
- Ödemhemmende Wirkung

**B 4,56 Hz, Rot 25**, Areal der Ernährung und der Assimilierung (Metabolismus)

- Stimulation der Nährstofffunktionen, des interzellulären Austauschs, der Zellkohäsion, der immunologischen Phänomene
- Antiallergische Wirkung

**C 9,12 Hz, Gelb 3**, kinetisches Areal, repräsentiert die Bewegung. Stimulation der Funktionen:

- Der Fortbewegung
- Der Muskelkontraktion
- Verbindung mit Agonismus und Antagonismus
- Verbindung zur Dopaminausschüttung

**D 18,25 Hz, Rot 24**, assoziatives Areal, repräsentiert die Verbindung zwischen der linken und rechten Körperhälfte

- Stimulation der interhemisphärischen Fasern, führt zu einer Stimulation der Funktionen, die mit Symmetrie und Lateralität verbunden sind.
- Wirkung auf Motorik, Gang, Körperhaltung
- Wirkung auf Sprache, Stimmung, Konzentration, Gedächtnis, Bezug zu Zeit/Raum

**E 36.50 Hz, Blau 44**, Areal der Verteilung, repräsentiert die Reizübertragung zwischen Kortex und Soma

- Stimulation des Rückenmarks
- Schmerzstillende Wirkung

**F 73 Hz, Blau 98, Hz**, subkortikales Areal, repräsentiert die instinktive Organisation

- Stimulation der Basalganglien
- Wundheilende, antidepressive Wirkung,
- Regulierung des Hypothalamus und des Appetits

**G 146 Hz, Magenta 30**, kortikales Areal, repräsentiert die mentale Organisation

- Stimulation der Hirnrinde
- Behandlung psychosomatischer Erkrankungen
- Behandlung chronischer Schmerzen
- Zusatzbehandlung der Epilepsie

Ausgehend von den Hauteigenschaften und den Merkmalen des Lichts, die das Phänomen der Lichtwahrnehmung der Haut auslösen, entwickelte Sedatelec Geräte, mit denen weißes, farbiges, gepulstes oder kontinuierliches Licht gemäß den Nogier Frequenzen\*\* erzeugt werden kann.

Diese Geräte werden je nach Modell zur Diagnose und zur Stimulation eingesetzt und funktionieren zum Großteil in Verbindung mit der Nogier-Pulsmessung.

# premio 40 Light

## LICHT UND FARBSTIMULATION



Farb- oder Licht- Punktsuche- und Stimulationsgerät mit Dauerlicht oder Frequenzlicht. Dieses hochpräzise Gerät ist ideal für die Aurikulomedizin, die Photonotherapie® und die Farbtherapie. Medizinprodukt der Klasse I.

### ✓ STÄRKEN

- Verwendung aller Sedatelec-Filter und -Scheiben (> 150 Referenzen)
- Kabellos und autonom für einfache und uneingeschränkte Bedienung
- Bestrahlung von einem Ø 2 mm Punkt, bis zur einer Fläche von Ø 20 cm

### 112953 - PREMIO 40 LIGHT

36x35x8 cm - 1270 g - Stoßsicherer Transportkoffer

Ein Transportkoffer mit:

- 1 Premio 40 Light
- 1 Gebrauchsanleitung
- 1 geschützte 900 mA Batterie (112099 PREM-08)
- 1 USB-Ladegerät
- 1 Scheibenhalter
- 1 Ø2 mm Aufsatz
- 1 Ø5 cm Aufsatz
- Vorgestanzter Koffer zur Aufbewahrung von bis zu 30 Filtern und 5 Scheiben (siehe Foto mit Optionen). Hinweis: Farbfilter und Scheiben sind optional.



*Non-binding picture*

### OPTIONEN FÜR DIESES GERÄT:

A	<b>113512 PREM-03-V2</b> Premio Halterung
B	<b>113050 PREM-06</b> Batterieverlängerung für PREM-09 <i>für Seriennummern &lt; 569</i>
B	<b>113050 PREM-06</b> Batterieverlängerung für <b>PREMIO 40 - TITAN</b> <i>für Seriennummern &gt;= 569</i>
C	<b>113001 PREM-09</b> Geschützte 3500 mA Batterie, 3,6 V
D	<b>113074 PREM-07</b> Optische Faser mit abnehmbarer Spitze
E	Filter : 1 Farbe (Siehe Liste auf der Seite 36)
F	ELD Scheiben (Siehe Liste auf der Seite 38)





## AN DIE PRAXIS ANGEPASSTE STIMULATION...


- Einstellung der niedrigen Intensität (Punktsuche) auf 4 Stufen und der hohen Intensität (Stimulation) auf 6 Stufen
- Nogier-Frequenzen: von A bis G und U Frequenz, in Basisfrequenzen, mit der Möglichkeit höhere Harmonische Frequenzen und die L Frequenz zu verwenden.
- Frequenzvariation von -30% bis +30% in 5%-Schritten
- Automatische Scanfunktion aller Nogier-Frequenzen mit allen Prozentwerten
- Lateralitätstest mit der Schwebungsfunktion (BF, HF, HF + BF)

## WIRKSAMKEIT DER STIMULATION

- Hochentwickelte elektronische Steuerung
- Stabilität der Einstellungen : 32-Bit-Mikroprozessor.
- Frequenzemission mit einer Genauigkeit von 0,01%.



## HIGH C.R.I. DIODE BREITES SPEKTRUM UND FARBGLEICHGEWICHT

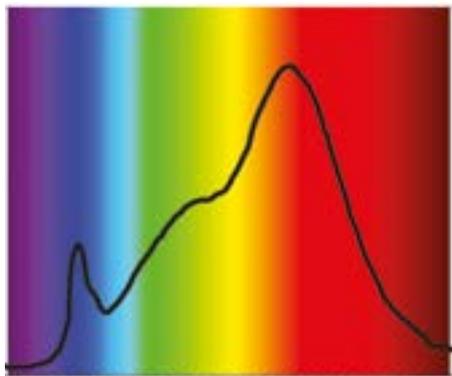

- High C.R.I. (Color Rendering Index) Diode der neuesten Generation, mit einem weiß Licht Spektrum, dass dem der Sonne sehr nahe ist
- Sehr hohe einstellbare Beleuchtungsstärke von 780 Lux bis 51 500 Lux aus 5 cm
- Eine einzige Diode anstelle von drei klassischen RGB-Dioden, deren monochromatische glockenförmige Emission die gewünschte spektrale Abdeckung nicht erreichen
- Eine sehr geringe Erwärmung der Quelle, um unabhängig von den verwendeten Gelatinefiltern, eine gleichbleibende Qualität zu erhalten



# WÄRMESTIMULATION

## SICHERE MOXIBUSTION

Die therapeutische Anwendung von Wärme ist eine nicht invasive Behandlungsmethode. Sie fördert die Muskelentspannung, lockert Verspannungen, steigert die lokale Durchblutung, stimuliert das Immunsystem und ermöglicht eine wirksame Bekämpfung des Schmerzes. In der Traditionellen Chinesischen Medizin nimmt sie einen ganz besonderen Stellenwert ein: Seit Jahrtausenden wird sie auf täglicher Basis unter dem Namen Moxibustion eingesetzt.

Die Stimulation durch Wärme, die durch die flammenfreie Verbrennung von Beifuss entsteht, wird in China, aber auch in Japan angewendet. Sie ist derzeit Gegenstand von umfangreichen wissenschaftlichen und klinischen Forschungen, die die zahlreichen und unterschiedlichen implizierten physiologischen Mechanismen aufzeigen.

### AUF LOKALER EBENE:



Löst die Stimulation der Thermorezeptoren die Freisetzung von Mediatoren (P Substanz, Somatostatin, ...) aus, die eine unmittelbare Wirkung zeigen, indem sie eine Entzündung verursachen:

- Eine anfängliche **Vasokonstriktion** von sehr kurzer Dauer, wahrscheinlich ein Reflex der Gefäßwand
- Eine **Vasodilatation** und eine erhöhte Durchblutung durch antidrome Stimulation des afferenten Axons
- Eine **Aktivierung** der Mastzellen und des Immunsystems im weiteren Sinne (Steigerung der Blutpopulation und der Aktivität der weißen Blutkörperchen) über einen relativ langen Zeitraum (länger als 2 Wochen)

## EIGENSCHAFTEN DES BEIFUSSSPEKTRUMS BEI DER VERBRENNUNG...

Wird Beifuss mit einem Feuerzeug oder einem Räucherstäbchen entzündet, verbrennt es flammenfrei, glimmend und bildet Asche, die, falls sie nicht beseitigt wird (durch Herabfallen oder durch eine Geste des Therapeuten), die Verbrennung des Beifusses verlangsamt und sein Emissionsspektrum verändert.

**Die ausgesendete Wärme erfolgt in Form von elektromagnetischer Strahlung, d.h. von Energieträgerwellen. Das Emissionsspektrum liegt sehr nahe an dem eines Schwarzkörpers.**

Ein Schwarzkörper bezeichnet einen Gegenstand, dessen elektromagnetisches Spektrum – d.h. die Verteilung der Energiemenge entsprechend der Wellenlänge ausschließlich von seiner Temperatur abhängig ist.

Diese Kurve hat eine spezifische, kontinuierliche Form mit einer Spitze, die der Wellenlänge entspricht, die am meisten Energie zuführt, sowie einem mehr oder weniger steilen Abfall für die unteren und oberen Wellenlängen.

# BEIFUSS, EINE SEIT LANGEM GENUTZTE WÄRMEQUELLE

## BESONDERE WÄRMEQUALITÄT

Bei der Moxibustion in ihrer ursprünglichsten Form wurden vermutlich unterschiedliche Materialien verwendet, wie erhitzte Steine (deren Verwendung auch heute noch aktuell ist), Tabak, Baumwolle, Schwefel, Aconit... Beifuss wurde jedoch seit jeher aufgrund der Wärmequalität geschätzt, die bei der Verbrennung dieses getrockneten und anschließend zermahlenen Krauts entsteht und das in dieser Form, oder aber zu einem Kegel oder einer Rolle gerollt verwendet wird...

Das Kraut gab sogar der Heilmethode außerhalb Chinas seinen Namen, denn der Begriff Moxa kommt vom japanischen Mogusa, was Beifuss bedeutet!




## GERUCHSINTENSIVER RAUCH

Beifuss, dessen ätherisches Öl für seine Heilkraft bekannt ist, wird ebenfalls in der Kräuterheilkunde verwendet, verfügt jedoch auch über nicht zu vernachlässigende giftige Eigenschaften, was seine professionelle Anwendung erfordert und versierten Therapeuten vorbehalten ist.

Das Einatmen seines Rauchs kann sich langfristig als giftig erweisen. Andererseits entsteht wie bei jeder Verbrennung Asche, die, wenn sie während einer Sitzung herunterfällt, erhebliche Verbrennungen auf der Haut des Patienten hinterlassen können.



## BEIFUSS: EIN SPEKTRUM IM INFRAROTWELLENBEREICH

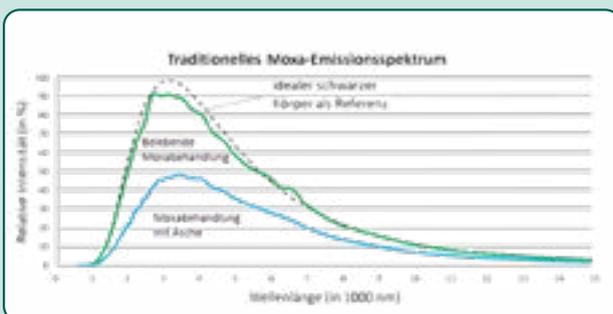

Beifuss weist bei der Verbrennung ein sehr breites Emissionsspektrum auf, dessen Wellenlängen sich von Rot (im sichtbaren Spektrum) und kurzen Infrarotwellen mit einer Spitze innerhalb der mittleren Infrarotwellen und einem hohen Anteil an langen Infrarotwellen erstreckt. Wird die Verbrennung aktiviert, beispielsweise indem man darauf bläst, steigt die Temperatur des Beifusses auf 850-900°C, die Spitze des Spektrums liegt bei 2,6µm und der Anteil kurzer und mittlerer Infrarotwellen ist erheblich.

Bei Abschwächung der Verbrennung (wenn sich z.B. Asche bildet) fällt die Temperatur des Beifusses auf etwa 650°C, die Spitze liegt nahe 3µm und verschiebt das Spektrum nach unten (geringere Energieübertragung) und zu den langen Infrarotwellen.

**Die Verteilung der Wellenlängen auf eine solch breite Skala ist eine fundamentale Eigenschaft von Beifuss und erklärt zum großen Teil seine Effizienz aufgrund seiner Adäquanz mit den physiologischen Rezeptoren des Organismus, Wärme- und Lichtrezeptoren.**

Es genügt nicht, einfach nur kalorische Energie zuzuführen, denn diese Wärmezufuhr muss auch absorbiert und assimiliert werden können und dies hängt natürlich vom elektromagnetischen Sensibilitätsfenster der Rezeptoren ab. Außerdem dürfen die auf Außentemperaturen empfindlich reagierenden Wärmerezeptoren der Haut nicht übersättigt werden, die bei Überschreiten der Toleranzschwelle beim Patienten aufgrund von Schmerzempfinden zu einem Rückzugreflex führen und so die Anwendungszeit einschränken.

# premio 10 moxa

## HEAT STIMULATION



Innovativ: Der PREMIO 10 MOXA ist das 1. elektrische Moxationsgerät, das speziell für dieselbe Wirksamkeit wie die traditionelle Moxibustion entwickelt wurde.

Sie begünstigt die Entspannung der Muskeln, reduziert Verspannungen, sie steigert lokal die Durchblutung, stimuliert das Immunsystem ... Diese Wärme ermöglicht die wirksame Bekämpfung des Schmerzes. Medizinprodukt der Klasse IIa.

### ✓ STÄRKEN

- Der IR Sender verfügt über identische Eigenschaften wie die von Beifuss bei der Verbrennung.
- Sehr einfach und schnell Anwendungsbereit
- Einsetzbar in Krankenhäusern (kein Rauch, kein Geruch)
- Dank des USB-Anschluss, mit tragbarem Akku nutzbar

### 111237 - PREMIO 10 MOXA

26x20x7 cm - 450 g - Stoßsicherer Transportkoffer

Ein Transportkoffer mit:

- 1 Premio 10 Moxa
- 1 Gebrauchsanleitung
- 1 Universal USB-Netzteil
- 1 Konzentrator (111848 PREM10-01)



### OPTIONEN FÜR DIESES GERÄT:

A	<b>112747 PREM-03</b> Premio Ständer
---	--------------------------------------



## WIRKSAMKEIT DER STIMULATION

### IN DER AKUPUNKTUR



Vertraute Gesten, bekannte Ergebnisse.

### IN DER AURIKULOTHERAPIE



Eine neue und präzise Stimulationstechnik in wenigen Sekunden.

### LOKALTHERAPIE



Eine präzise, sichere

### « THERMONADEL »-EFFEKT



Eine blitzschnell durchdringende Wärme: Der Konzentrador fokussiert die Strahlung wenige Sekunden lang auf einen präzisen Punkt.

## OHNE DIE NACHTEILE DES MOXAKRAUTS:


- Kein giftiger Rauch
- Keine lästigen Gerüche,
- Kein schwieriges Anzünden und Löschen,
- Keine brennende Asche, die das Beifußkraut abkühlt.



## DAS EINZIGE « MOXA-LIKE »-GERÄT

Der speziell für den PREMIO 10 MOXA entwickelte IR-Strahler hat das gleiche Emissionsspektrum wie glühendes Beifußkraut, sowohl hinsichtlich der Bandbreite des Spektrums als auch der Verteilung der Wellenlängen im nahen, mittleren und fernen Infrarotbereich. Diese führen zu einer Mobilisierung der physiologischen Rezeptoren jeglicher Art und Tiefe, die der traditionellen Moxa- Zigarre entspricht.

Seine Wirksamkeit ist vor allem auf die große Bandbreite der Wellenlängenverteilung und deren Adäquanz mit den physiologischen Thermo- und Photorezeptoren des Organismus zu erklären.

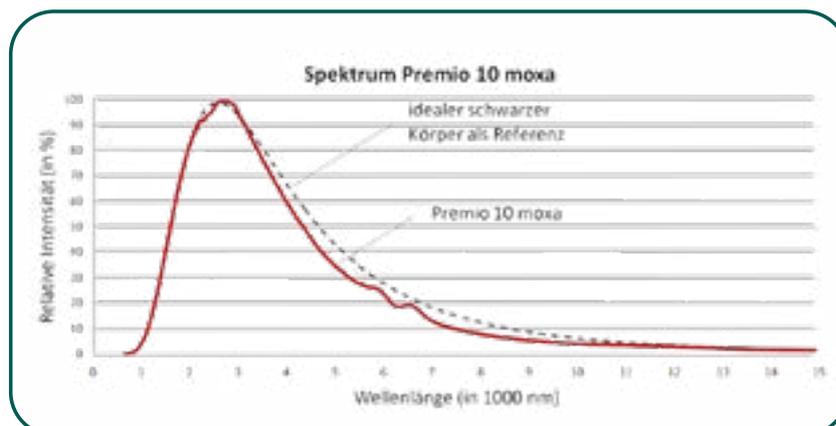

# INSTRUMENTE & DIDAKTISCHES MATERIAL



**Die folgenden Produkte unterliegen nicht der Medizinprodukte Verordnung (EU) 2017/745.**

Ob für die Ausbildung oder für Ihre tägliche Praxis, Sedatelec bietet hochwertige Instrumente, die vollständig in Frankreich.

## DRUCKTASTER

Diese Instrumente von Sedatelec sind für einen Einstieg in die Aurikulotherapie unerlässlich. Sie werden in der Aurikulotherapie häufig für die Lokalisierung von Schmerzpunkten in der Ohrmuschel. 4 Druckintensitäten je nach gewünschtem Widerstand.



<b>103609 - PAL 130 - DRUCKTASTER 130G SCHWARZ</b>		
<b>103304 - PAL 250 - DRUCKTASTER 250G BLAU</b>		
<b>103610 - PAL 400 - DRUCKTASTER 400G ORANGE</b>		
<b>103611 - PAL 650 - DRUCKTASTER 650G BEIGE</b>		
14.5x1x1 cm	25g	Plastiktüte mit 1 Drucktaster

## MULTI-DRUCKTASTER

Revolutionär durch seinen großen Messbereich (von 0 bis ca. 400 Gramm), ergonomisch, praktisch und präzise: der EASYO 1 wird Sie über lange Jahre in Ihrer Praxis begleiten. Die farbigen Markierungen helfen Ihnen dabei, das Druckniveau präzise einzuschätzen, d.h. die Intensität bzw. die Tiefe, bei der Sie eine Reaktion erkennen.



<b>112353 - EASYO1 - MULTI-DRUCKTASTER</b>		
17x6x3 cm	30g	Plastiktüte mit 1 Drucktaster

## GLASSTÄBE

Die Stäbe aus geschliffenem Glas sorgen für eine hohe Massagequalität, ohne Hautreizungen auszulösen. Mit der dünnen und glatten Spitze können die Ohrpunkte sehr präzise massiert werden.

**BAT02**



**BAT03**



<b>103607 - BAT02 - GLASSTÄBE</b>		
<b>113193 - BAT04 - BLAU GLASSTÄBE</b>		
13.5x1x2 cm	10g	Plastiktüte mit 2 Stäbchen

## MEDIZINISCHES SILIKON-OHR

**Sehr realistische Wiedergabe des Ohres.** Nützlich, um die Punkte zu verorten und Ihren Patienten oder Schülern zu zeigen. Durch die hervorragende Qualität können zahlreiche Nadelpunktionen durchgeführt werden, ohne dass das Ohr beschädigt wird.



**103350 - ORED - RECHTES OHR**

**103349 - OREG - LINKES OHR**

8.5x5.5x4 cm

80g

Plastiktüte mit 1 Ohr

## OHRSTEMPEL (HOLZ ODER SELBSTFÄRBEND)

Mit diesen Ohrstempeln können Sie die in Ihrer Sprechstunde behandelten Punkte markieren. Stempelabdruck in zwei Ausführungen erhältlich, mit oder ohne Hinteransicht.

**TAMB**



**103179 - TAMB1 - OHRSTEMPEL HOLZ NR. 1**

**103602 - TAMB2 - OHRSTEMPEL HOLZ NR. 2**

11.5x6x5 cm

153g

Plastiktüte mit 1 Stempel

**TAME**



**103603 - TAME1 - OHRSTEMPEL, SELBSTFÄRBEND NR. 1**

**103604 - TAME2 - OHRSTEMPEL, SELBSTFÄRBEND NR. 2**

11.5x6x5 cm

153g

Plastiktüte mit 1 Stempel

N°1



N°2



## PATIENTENERDUNG

Wird verwendet, um elektrostatische Ladungen des Körpers in die Erde abzuleiten. Sie enthält eine abnehmbare Elektrode, die mit einem Tuch gereinigt werden kann. Für eine flexible Anwendung können zusätzliche Elektroden erworben werden. Passt in EU- oder US-Steckdosen.



**112698 - DMAT - PATIENTEN-ERDUNGSVORRICHTUNG EU**

**113095 - DMAT US - PATIENTEN-ERDUNGSVORRICHTUNG US**

13.5x6x1.9 cm

100g

Plasticised bag containing 1 device

**112804 - DMAT 01 - ELEKTRODEN FÜR DIE PATIENTEN-ERDUNG**

8x5x1 cm

30g

Plasticised bag containing 2

## ANZEIGER FÜR ANTI-TABAK-BEHANDLUNG, WINKELMESSER 30°

Anzeiger für Anti-Tabak-Behandlung, transparente Platte mit 7 Rillen für die Anti-Tabak-Behandlung. Winkelmesser, transparente Platte mit 30°-Winkel-Einteilungen (Ohrgeometrie).



**103347 - RAPAT - ANZEIGER ANTI-TABAK-BEHANDLUNG**

**103606 - RAP30 - WINKELMESSER 30°**

14x11x5 cm

50g

Plastiktüte mit 1



## FARBFILTER

Es ist ein ganzes Sortiment an Farbfilttern, Farbenfrequenzprogrammen, Metall-, Magnet- und polarisierten Filtern verfügbar. Die Zusammensetzung der Filterhalter wurde speziell so konzipiert, dass sie die Pulsreaktion nicht beeinträchtigen.

### FILTER LEE: 1 FARBE

GELB FILTERS		VEILCHENBLAU FILTERS		GRÜN FILTERS	
103410	- Gelb L007 = <b>C</b>	107349	- L128 = <b>G</b> 30	107343	- Grün L088 = L 58
107333	- Gelb L010	107367	- Veilchenblau L641	107344	- Grün L089
107346	- Gelb L102 = 12	113447	- Veilchenblau 797 (=49B)	107345	- Grün L090
107347	- GelbL103			107348	- Grün L124
107361	- Gelb L212			107363	- Grün L322
113479	- Gelb L101 =12			107364	- Grün L323
				107365	- Grün L325
				113478	- Grün L736 = 53
ORANGE FILTERS		BLAU FILTERS		AUTRES	
107332	- Orange L008	107341	- Blau L071 = 49	107604	- Ektoderm L116
107334	- Orange L013	107342	- Blau L075	107607	- Mesoderm L248
107337	- Orange L020 = <b>A</b> 21	107350	- Blau L137	107793	- Endoderm - L1410
		107351	- Blau L140	107366	- Acetylcholin L328
		107353	- Blau L180	107352	- Noradrenalin L148
		107354	- Blau L181	107362	- Schwarz L299 = 90
		107355	- BlauL183	113043	- Farblos L226 = 1A
		107356	- Blau L195		
		107357	- Blau L196		
		107358	- Blau L197		
		107792	- Blau L198 <b>E</b>		
		107359	- Blau L201 = <b>F</b> 44		
		107368	- Blau L363 = 98		
		107369	- Blau L366		
		113469	- Blau L241		
		113467	- Blau L079		
ROT FILTERS		BROWN FILTERS			
107336	- Rot L019	107335	- Brown L017 = 15		
107338	- Rot L022	107360	- Brown L208		
107339	- Rot L024 = <b>D</b> 24				
107340	- Rot L026 = <b>B</b> 25				
111753	- Rot L113				

#### ART.-NR. - FILLIC-N° - 1 FARBE L FILTER

8.5x5.5x0.5 cm	30g	Plastiktüte mit 1 Filter
----------------	-----	--------------------------



## FILTER KODAK: 1 FARBE

GELB FILTERS			MAGENTA FILTERS			BLAU FILTERS		
112395	- Gelb 2		107169	- Magenta 30	G	107687	- Blau 46	
107375	- Gelb 3	C	111129	- Magenta 31		107178	- Blau 47	
103369	- Gelb 4		107170	- Magenta 32		107179	- Blau 47B	
112630	- Gelb 6					107688	- Blau 48A	
107158	- Gelb 8		VEILCHENBLAU FILTERS			107181	- Blau 50	
112659	- Gelb 8N5		107172	- Veilchenblau 34		107194	- Blau 75	
107159	- Gelb 9		107173	- Veilchenblau 34A		107195	- Blau 78	
107162	- Gelb 16		107174	- Veilchenblau 35		112475	- Blau 78C	
107163	- Gelb 22		107201	- Veilchenblau 97		107692	- Blau 80B	
107191	- Gelb 72		GRÜN FILTERS			107693	- Blau 80C	
107192	- Gelb 73		107684	- Grün 11		112393	- Blau 80D	
ORANGE FILTERS			107685	- Grün 13		107695	- Blau 82C	
107221	- Orange 21	A	112443	- Grün 40		107200	- Blau 94	
109260	- Orange 85		107184	- Grün 55		107202	- Blau 98	F
112396	- Orange 85N6		107690	- Grün 57		CYAN FILTERS		
107698	- Orange 106		107185	- Grün 58	Ø2	112033	- Cyan 38	
			107186	- Grün 59		107175	- Cyan 38A	
ROT FILTERS			107188	- Grün 61		107686	- Cyan 45	
107164	- Rot 23A		107193	- Grün 74		107691	- Cyan 64	
107165	- Rot 24	D	107697	- Grün 93		SCHWARZ FILTERS		
107168	- Rot 29		107203	- Grün 99		107196	- Schwarz 87	
107190	- Rot 70		112926	- Grün 102		107696	- Schwarz 87C	
107199	- Rot 92					107197	- Schwarz 89B	

### ART.-NR. - FILIC-N° - 1 FARBE FILTER

8.5x5.5x0.5 cm	30g	Plastiktüte mit 1 Filter
----------------	-----	--------------------------

Die Kodak-Filter werden nach und nach durch LEE-Filter ersetzt.

(\*Verfügbar, solange der Vorrat reicht\*)

1/9/22 :


Farblos 1A = L226 - Gelb 12 = L102 - Gelb 15 = L017 - Rot B25 = L026 - Blau 44 = L201

Blau 49 = L071 - Schwarz 90 = L299

Bitte kontaktieren Sie Ihren Trainer für weitere Informationen.

## FARBFREQUENZPROGRAMM PCF-LEE

Das Farbenfrequenzprogramm PCF-LEE ist die Basisausrüstung für die Verwendung von Filtern in der Aurikulomedizin.

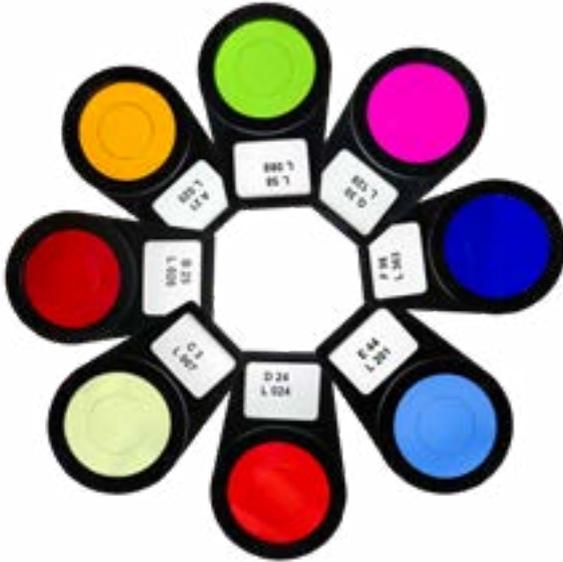

- Frequenz **A** 21 = Lee 020
- Frequenz **B** 25 = Lee 026 → Phase 1
- Frequenz **C** 3 = Lee 007
- Frequenz **D** 24 = Lee 024
- Frequenz **E** 44 = Lee 201 → Phase 3
- Frequenz **F** 98 = Lee 363
- Frequenz **G** 30 = Lee 128
- Frequenz **L** = 58 = Lee 088 → Phase 2

### 113291 PCF LEE - FARBFREQUENZ-PROGRAMM LEE

20x6x18 cm	180g	Plastiktüte mit 8 Filter
------------	------	--------------------------

## SCHEIBEN FÜR PREMIO 40



**112615- ELD-D3**  
D3 Disc:  
9/64/12/44A/24/31



**113073 - ELD-GIR**  
Rote und Infrarotscheibe



**112616 - ELD-D4**  
D4 Disc:  
21/44/61/24/25/58



**112728 - ELD-PCF**  
Disc PCF LEE :  
L020 (A21) / L026 (B25)  
L007 (C3) / L024 (D24)  
L0201 (E44) / L636 (F98)  
L128 (G30)

### 112497 - ELD-DV - LEERE SCHEIBE, FÜR PERSONALISIERBARE FARBEN

5x8x0.5 cm	30g	Einzelne Plastiktüten
------------	-----	-----------------------

*Auf Anfrage können Sie Ihre eigenen Scheiben mit Farben nach Wunsch herstellen lassen. Mindestmenge für Schulen oder Lehrkräfte.*

## FILTER: 2 ODER MEHR FARBEN

Mit diesen Filtern können zwei Farben oder zwei Wirkungen gleichzeitig getestet werden. Sie bestehen aus zwei in einem Filter übereinander gelagerten Folien.

Auf Anfrage können wir auch spezifische Farbkompositionen herstellen.

### FILTER: 2 FARBEN (ÜBEREINANDERLIEGEND)



**107207 - FIL2S-3016** - Filter 2 C Überlagert 30/16\*

**113449 - FILL1C-797-K49B** - Filter L 2 C Überlagert 148 (= 30/32\*)

**113448 - FILL2S-017127-K3390** - Filter L 2 C Überlagert 017/127  
(= 33/90)

8.5x5.5x0.5 cm	30g	Plastiktüte mit 1 Filter
----------------	-----	--------------------------

*\*Erhältlich, solange der Vorrat reicht*

### FILTER: 3 FARBEN (ÜBEREINANDERLIEGEND)



**107243- FIL3S-212544** - Filter 3 C Überlagert 21/25/44\*

**107244 - FIL3S-2165A58** - Filter 3 C Überlager t21/65A/58\*

**107238 - FIL3S-254458** - Filter 3 C Überlagert 25/44/58 Lee

**109467 - FIL3S-255824** - Filter 3 C Überlagert 25/58/24\*

**107240 - FIL3S-305899** - Filter 3 C Überlager t30/58/99 Lee

**103371 - FIL3S-442524** - Filter 3 C Überlagert 44/25/24\*

8.5x5.5x0.5 cm	30g	Plastiktüte mit 1 Filter
----------------	-----	--------------------------

*\*Erhältlich, solange der Vorrat reicht*

### FILTER: 3 FARBEN (STERN)



**107245 - FIL3E-254458** - Filter 3 C stenform 25/44/58 Lee

**107248 - FIL3E-2165A24** - Filter 3 C stenform 21/65A/24\*

**107249 - FIL3E-245865A** - Filter 3 C stenform 24/58/65A\*

**107668 - FIL3E-244458** - Filter 3 C stenform 24/44/58

8.5x5.5x0.5 cm	30g	Plastiktüte mit 1 Filter
----------------	-----	--------------------------

*\*Erhältlich, solange der Vorrat reicht*

## ANDERE FILTER



<b>103376</b> - FILOR - Filter Gold (auf Anfrage)
<b>103377</b> - FILAR - Filter Silber (auf Anfrage)
<b>103378</b> - FILNB - Filter schwarz/weiß
<b>103379</b> - FILNBPOL - Filter schwarz/weiß gepolt
<b>103380</b> - FILMAG - Filter, magnetisch
<b>103381</b> - FILMAGPOL - Filter, magnetisch gepolt
<b>110219</b> - FILMAGN/S - Filter, magnetisch Nord-Süd
<b>110221</b> - FILMAGN/SPOL - Filter, magnetisch Nord-Süd gepolt
<b>103384</b> - FILPOL - Filter, Polaroid
<b>103382</b> - FILPOLC - Filter, Polaroid gekreuzt
<b>103387</b> - FILARG - Filter, Tonerde (Argile)
<b>103400</b> - FILET04 - Filter, Raum-Zeit (4er-Set)
<b>103407</b> - POL612 - Polaroidplatte 6 x 12 cm
<b>103408</b> - POL1015 - Polaroidplatte 10 x 15 cm
<b>113336</b> - FILCIR4GRDR - Zirkularer Filter 4Dr/Gr

8.5x5.5x0.5 cm	30g	Plastiktüte mit 1 Filter
----------------	-----	--------------------------

## LEERFILTER ANOTEST®

Set bestehend aus 10 durchsichtigen Scheiben (positiv) und 10 Scheiben (negativ), 10 aschefreie Absorptionsplättchen und 10 Gummi-Leerfilter, um Ihre eigenen Filter herzustellen (ATEST10). Es besteht die Möglichkeit, die Gummi-Leerfilter (ATEST-01), die positiven/negativen Scheiben (ATEST-02) separat zu kaufen.



<b>107472 - ATEST10 - 10 LEERFILTER FÜR FILTER</b>		
15x10x3 cm	150g	Plastiktüte mit 10 kompletten Filtern

<b>103507</b> - ATEST-01 - 10 Gummi-Leerfilter
<b>103255</b> - ATEST-02 - 10 durchsichtige Scheiben positiv/negativ

## FILTERBRILLENHALTER

Spezialbrille in der sie unsere FarbfILTER anbringen können damit der Patient die vom Therapeuten ausgewählten Farben sehen kann.



<b>113388 - LUMAL - FILTERBRILLENHALTER</b>		
19x8x6.5 cm	100g	Kartonverpackung

*Nicht vertraglich bindendes Bild.*

## FILTER AUFBEWAHRUNGSSCHACHTEL

In dieser Aufbewahrungsschachtel können Sie bis zu 20 Filter einordnen.




### 103395 - ATEST-03 - AUFBEWAHRUNGSSCHACHTEL (20 F)

25x2x2 cm	180g	Einzelne Kunststoffverpackung
-----------	------	-------------------------------

*Nicht vertraglich bindendes Bild.*

## EASYO-SORTIMENT

Ergonomisch Detektoren, die aus verschiedenen Materialien bestehen.

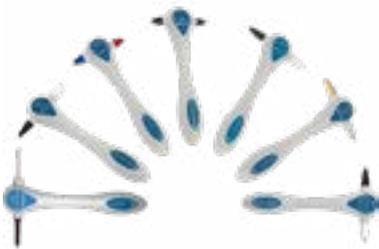

**112870 - EASYO2** - Langer schwarz-weißer Detektor

**112354 - EASYO3** - Kurzer schwarz-weißer Detektor

**112355 - EASYO4** - Detektor Nord-Süd

**112356 - EASYO5** - Detektor 3V

**112357 - EASYO6** - Detektor Bahr schwarz-weiß

**112358 - EASYO7** - Gold-Silber-Detektor

**113382 - EASYO8** - Dreifach-Bahr-Detektor

13.5x6x1.9 cm	100g	Plastifizierter Beutel mit 1 Detektor
---------------	------	---------------------------------------

## ENDONASAL-STIFTE

Wird in der Sympathikotherapie oder der nasalen Reflextherapie eingesetzt, um die Reflexpunkte der Nasenschleimhaut auf sanfte Weise zu stimulieren. Erhältlich in flexibler und halbstarrer Ausführung.



**103302 - STYSOU - FLEXIBLER STIFT**

**103303 - STYSER - HALBSTARRER STIFT**

20x0.5x0.5 cm	50g	Einzel in Kunststoff verpackt
---------------	-----	-------------------------------

## WATTESTÄBCHEN

Wattebausch mit Holzgriff, in Packungen mit 200 einzeln sterilisierten Einheiten verpackt.



**106708 - ECOU200 - SCHACHTEL MIT 200 WATTESTÄBCHEN**

20x1.5x7.5 cm	150g	Kartonverpackung
---------------	------	------------------



## BILDТАFЕLN

AUF FRANZÖSISCH	
<b>113087 - PLFB02-FR</b>	F. BAHR - Nouvelle Acupuncture de l'Oreille plastifiée (60x80)
<b>111752 PLCERS01-FR</b>	CERS TA Nasosympathicothérapie - Somatotopie interne
<b>B 113285 PLHRLEH01-FR</b>	H. R. LEHNER Carte d'auriculothérapie - Selon P. Nogier et R. Bourdiol 60x85cm
<b>D 113325 PLHRLEH02-FR</b>	H.R.LEHNER Carte d'Acupuncture Auriculaire pour les chiens et les chevaux-Ed. FUECHTENBUSCH -60x85cm
<b>109392 PLJVBA0217-FR</b>	J. V. BAARLE 21x30 Iridologie - FR - plastifiée
<b>109364 PLJVBA021-FR</b>	J. V. BAARLE 21x30 Méridiens - FR - plastifiée
<b>109366 PLJVBA022-FR</b>	J. V. BAARLE 21x30 Points Acupuncture - Alarme - MU - JU - FR - plastifiée
<b>109378 PLJVBA028-FR</b>	J. V. BAARLE 21x30 Chakras - FR - plastifiée
<b>109382 PLJVBA0210-FR</b>	J. V. BAARLE 21x30 Zones Réflexes Main - FR - plastifiée
<b>109386 PLJVBA0212-FR</b>	J. V. BAARLE 21x30 Zones Réflexes Main et Pied - FR - plastifiée
<b>109394 PLJVBA031-FR</b>	J. V. BAARLE 42x60 Méridiens - FR - plastifiée
<b>A 103608 PLPNRN01-FR</b>	P.F.M NOGIER présenté par R. NOGIER Cartographie de l'oreille 40x60 Ed.SEDATELEC
<b>A 112669 PLPNRN02-FR</b>	P.F.M NOGIER présenté par R. NOGIER Cartographie de l'oreille 20X30 Ed. Sedatelec

AUF ENGLISCH	
<b>D 112997 PLFB01-AN</b>	F. BAHR - Chart of the New Ear Acupuncture (60x80)
<b>106892 PLBFNS02-AN</b>	B.L. FRANK /N.E. SOLIMAN Auricular Therapy Reflex Chart - 21x27cm
<b>106891 PLBFNS01-AN</b>	B.L. FRANK / N.E. SOLIMAN Auricular Therapy Reflex Chart 60x90cm
<b>109458 PLBFNS03-AN</b>	B.L. FRANK / N.E. SOLIMAN Hand Acupuncture Reflex Chart 28x43 cm
<b>107383 PLBEIJ01-AN</b>	Beijing Acupuncture Institut, Official localisation of acupuncture points: 3 charts 1m x 0,80
<b>B 113284 PLHRLEH01-AN</b>	H. R. LEHNER Map of auriculotherapy - According to P. Nogier and R. Bourdiol 60x85cm
<b>D 113323 PLHRLEH02-AN</b>	H. R. LEHNER Map of ear acupuncture for Dogs and Horses - FUECHTENBUSCH Publishing - 60x85cm
<b>A 107378 PLPNRN01-AN</b>	P.F.M NOGIER présenté par R. NOGIER Ear chart 40x60 Ed.Sedatelec
<b>A 112670 PLPNRN02-AN</b>	P.F.M NOGIER présenté par R. NOGIER Ear chart 20X30 Ed.Sedatelec
<b>106751 PLTOLE01-AN</b>	T. OLESON Ear reflex points chart (en anglais) 1 planche / 1 chart 75 x 120 cm Edit. HCA - USA

## ANDERE SPRACHEN

	<b>109555 PLBFNS02-AL</b>	B.L. FRANK / N.E. SOLIMAN Reflexzonen für Ohrakupunktur - 21x27cm
<b>B</b>	<b>113322 PLHRLEH01-PT</b>	H. R. LEHNER Cartografia de Auriculoterapia - Segundo P. Nogier e R. Bourdiol 60x85cm
<b>A</b>	<b>107379 PLPNRN01-AL</b>	P.F.M NOGIER présenté par R. NOGIER Darstellung des Ohres 40x60 Ed.Sedatelec
<b>A</b>	<b>107381 PLPNRN01-ES</b>	P.F.M NOGIER présenté par R. NOGIER Cartografia de la oreja 40x60 Ed. Sedatemec
<b>A</b>	<b>112672 PLPNRN02-ES</b>	P.F.M NOGIER présenté par R. NOGIER Cartografia de la oreja 20X30 Ed. Sedatelec
<b>A</b>	<b>107380 PLPNRN01-IT</b>	P.F.M NOGIER présenté par R. NOGIER Mappa auricolare 40x60 Ed. Sedatelec
<b>A</b>	<b>112671 PLPNRN02-IT</b>	P.F.M NOGIER présenté par R. NOGIER Mappa auricolare 20X30 Ed. Sedatelec
<b>A</b>	<b>107382 PLPNRN01-HO</b>	P.F.M NOGIER présenté par R. NOGIER Oorkaart 40x60 Ed.Sedatelec

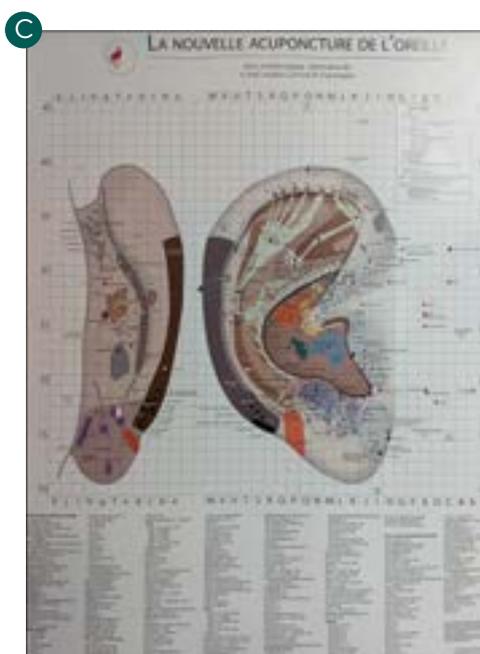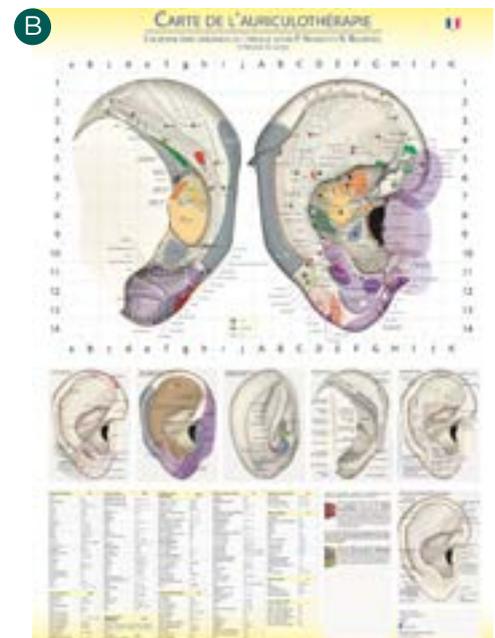

## BÜCHER

<b>AURIKULOTHERAPIE UND AURIKULOMEDIZIN (AUF FRANZÖSISCH)</b>	
<b>C 113136 LIALEN03-FR</b>	A.LENTZ Auriculomédecine rénovée et simplifiée 2ème édition
<b>111622 LICTER01-FR</b>	C. TERRAL Douleur et Acupuncture Edit. Sauramps medical
<b>113144 LICVUL02-FR</b>	C. VULLIEZ Auriculothérapie et pathologies bucco-dentaires Ed. Sauramps medical
<b>106881 LICVUL01-FR</b>	Ch. VULLIEZ Auriculothérapie appliquée à l'art dentaire Ed. Sauramps medical
<b>113337 LIFBFR02-FR</b>	F. R. BAHR Blessures psychiques - Traumatismes psychiques
<b>112969 LIFBFR01-FR</b>	F. R. BAHR La nouvelle acupuncture de l'oreille
<b>112399 LICACOLL01-FR</b>	ICAMAR Actes du premier colloque international d'auriculothérapie, auriculomédecine et médecine ph
<b>112708 LICACOLL02-FR</b>	ICAMAR Actes des rencontres Besançon 2014 d'Auriculo, médecine photonique et cranioacupuncture
<b>112709 LICACOLL03-FR</b>	ICAMAR Actes des rencontres Barcelone 2015 d'Auriculo, médecine photonique
<b>112026 LICAMAR01-FR</b>	ICAMAR French Review 2010 - 2011 237p.
<b>112400 LICAMAR02-FR</b>	ICAMAR Livre II en français années 2011-2012 n°4-5-6
<b>112707 LICAMAR03-FR</b>	ICAMAR Livre III en français années 2012-2013 n°7-8-9
<b>112880 LICAMAR04-FR</b>	ICAMAR Livre IV ANNEES 2013-2015
<b>113118 LICAMAR05-FR</b>	ICAMAR N°22
<b>112943 LILCOU-01-FR</b>	L. COUTURE L'acupuncture sur Oreille et Parkinson
<b>112945 LILCOU-02-FR</b>	L. COUTURE La Latéralité et L'auriculomédecine
<b>A 106806 LIPNOG01-FR</b>	P. NOGIER Introduction pratique à l'Auriculothérapie 169p. Ed. Satas
<b>106815 LIPNOG04-FR</b>	P. NOGIER L'homme dans l'oreille 256p. Ed. Maissonneuve
<b>106818 LIPNOGAL07-FR</b>	P. NOGIER ET Al Revue auriculomédecine 1975 à 1984 Ed. Maissonneuve
<b>106864 LIRNOG04-FR</b>	R. NOGIER Auriculothérapie 1er degré Ed. Sauramps medical
<b>110812 LIRNOG06-FR</b>	R. NOGIER Auriculothérapie 2ème degré 80p. Ed. Sauramps medical
<b>113305 LIRNOG10-FR</b>	R. NOGIER Le RAC - Réflexe Autonome Circulatoire
<b>110098 LIRSAN03-FR</b>	R. SANANES Guide de l'Arthrose Homéo Ed. Resurgence
<b>D 112879 LIYROU06-FR</b>	Y. ROUXEVILLE Les clés de l'auriculothérapie Edit. Satas
<b>113143 LIYROU07-FR</b>	Y. ROUXEVILLE Livre blanc de l'auriculothérapie en 2020 240p. Ed. Sauramps medical
<b>113394 LIALEN04-FR</b>	A.LENTZ L'auriculomédecine autrement
<b>G 112482 LIYMYR02-FR</b>	C. DE BRASSIER Acupuncture et auriculothérapie en obstétrique & gynéco
<b>H 110286 LIAPRI01-FR</b>	A. PRINTEMPS Pourquoi se soigner par Auriculomédecine 188p. Edit. GUENIOT
<b>I 106850 LIALEN01-FR</b>	A. LENTZ Auriculomédecine et Homéopathie Edition GUENIOT

**AURIKULOTHERAPIE UND AURIKULOMEDIZIN (AUF ENGLISCH)**






<b>C 113134 LIALEN03-EN</b>	A.LENTZ Auriculomedicine updated and simplified 2nd edition
<b>E 113123 LIJHAF01-AN</b>	J. HOWARD & A.FUECHTENBUSCH Auriculotherapy - The Atlas Based on the Originals by P. Nogier
<b>111335 LIKLAN01-AN</b>	K. LANDGREN Ear Acupuncture - Practical Guide 230 p. Edit. Elsevier
<b>111624 LIMROM01-AN</b>	M. ROMOLI Auricular Acupuncture Diagnosis Edit. Churchill Livinstone




**AURIKULOTHERAPIE UND AURIKULOMEDIZIN (AUF ENGLISCH)**

<b>111334 LIRNOG07-AN</b>	R. NOGIER Auriculotherapy Edit. Thieme
<b>B 112944 LILCOU-01-AN</b>	L. COUTURE Ear Acupuncture and Parkinson
<b>112946 LILCOU-02-AN</b>	L. COUTURE Laterality and Auriculomedecine

**AURIKULOTHERAPIE UND AURIKULOMEDIZIN (ANDERE SPRACHEN)**

<b>C 113158 LIALEN03-ES</b>	A.LENTZ Auriculomedecina renovada y simplificada 2ème édition
<b>106804 LIGLEM01-LL</b>	ANNALES DU GLEM 1995 à 2007 115p.
<b>F 113319 LIJPRI01-ES</b>	J. PRIETO DE MARÍA Terapia Auricular - Mandala Ediciones
<b>109354 LIPNOG08-LL</b>	P. NOGIER Correspondances fréquentielles (4 langues) (30 p.) Edit. Sauramps medical
<b>A 106809 LIPNOG01-IT</b>	P. NOGIER Introduzione pratica all'auricoloterapia (168 p.) Edit. LIBRERIA
<b>A 106808 LIPNOG01-AL</b>	P. NOGIER Praktische Einführung in die Aurikulotherapie 163 p. Edit. Satas
<b>J 109356 LIRNOG04-AL</b>	R. NOGIER Aurikulotherapie 1. Grades (97 p.) Edit. DR NOGIER/DR BAUDET

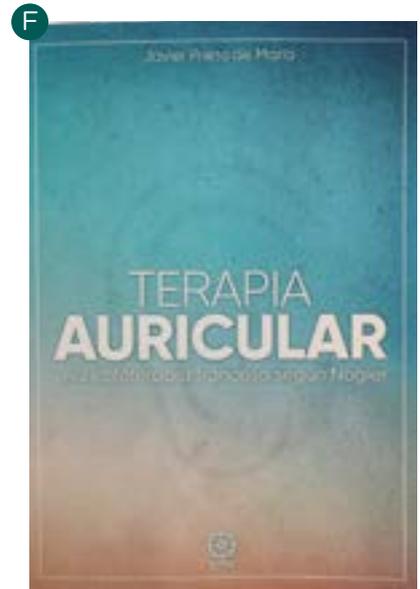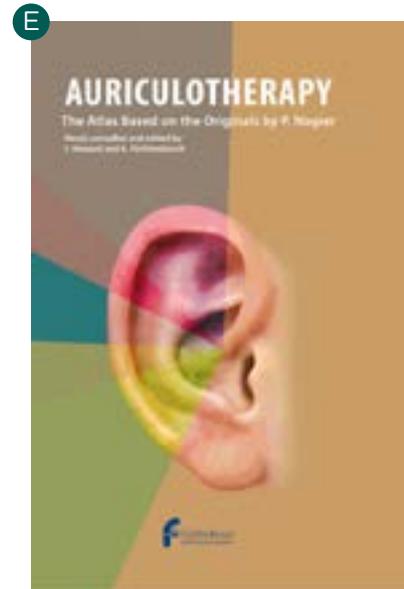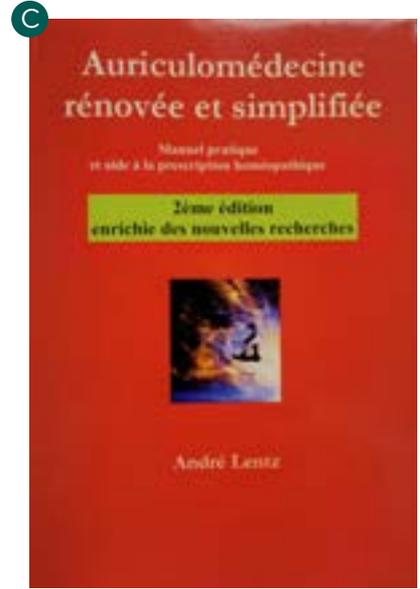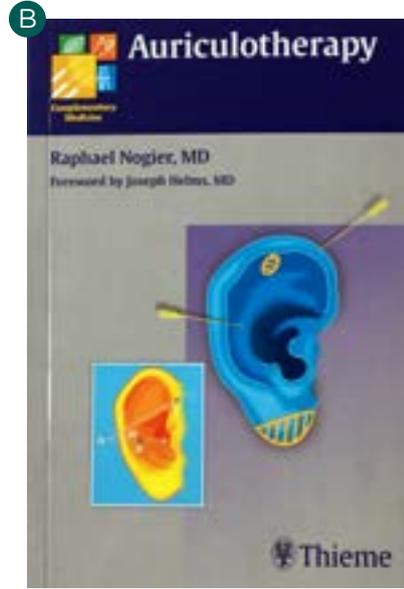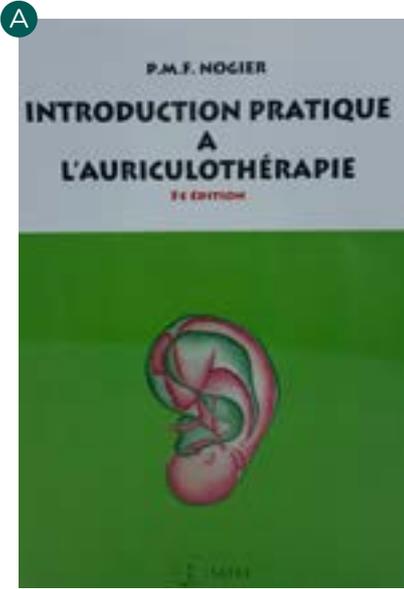

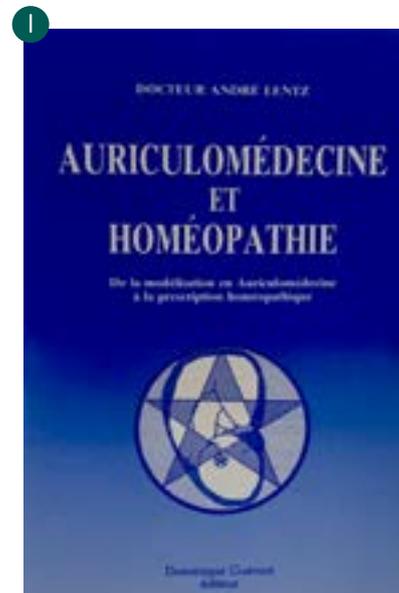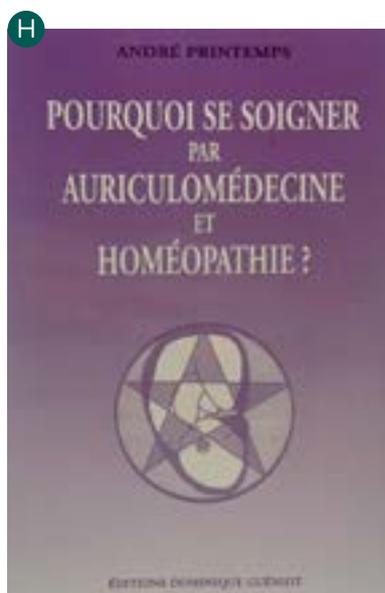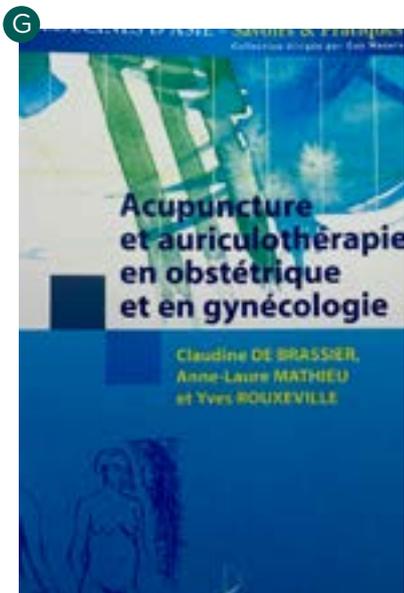

## BÜCHER

### AKUPUNKTUR (AUF ENGLISCH)

<b>A 110299 LIMPIQ01-AN</b>	M. PIQUEMAL Advance in Acupuncture with bioelectricity 122p. Edit. Y Arte SA
-----------------------------	--

### AKUPUNKTUR (AUF FRANZÖSISCH)

<b>112313 LIYROU05-FR</b>	Y. ROUXEVILLE Abrégé de physiologie à l'usage des acupuncteurs et des réflexothérapeutes (232p.) Edit. Springer
---------------------------	---

### LASER (AUF ENGLISCH)





<b>109352 LILHJT01-AN</b>	L. HODE, J. TUNER The LASER Therapy Handbook (590 p.) Edit. Prima Books
<b>B 113149 LIPBEC01-EN</b>	P. BECU Laser Biostimulation : 12 questions to ask yourself. 118 p
<b>C 113463 LIVKF01-AN</b>	V. KREISEL and A. FUECHTENBUSCH "Laser Acupuncture and Laser Ear acupuncture"
<b>D 113455 LIVAFWB01-AN</b>	A. FUECHTENBUSCH and Wolfgang Bringmann Laser Therapy and Laser Puncture - Treatment tables

### LASER (AUF FRANZÖSISCH)

<b>E 106882 LICVRN01-FR</b>	Ch. VULLIEZ-R. NOGIER Précis de laserthérapie en odonto-stomatologie Edit. Jollois
<b>B 113148 LILHJT01-FR</b>	P. BECU La Biostimulation Laser : Les 12 questions à se poser. 118 p

### ANDERE



<b>113163 LICBRE01-FR</b>	C. BRETIN DIEN CHAN Réflexologie Faciale Leduc pratique, 501 p
<b>113058 LIDHEN03-FR</b>	D. HENRY Guide thérapeutique en Médecine des Ventouses Edit. Guy Tredaniel
<b>112457 LIHHECKER-AN</b>	H-U HECKER. K LIEBCHEN - Acupressure Taping Edit. Healing Arts Press
<b>110989 LIJCJL01-FR</b>	J.R. CHENARD, J. LI Maux de dos Med. chinoise Med. moderne Edit. Maloine
<b>110997 LIMDOS01-FR</b>	M. DOSCH Atlas des techniques de neuralthérapie Edit. Haug
<b>110998 LIMDOS02-FR</b>	M. DOSCH Introduction aux techniques de neuralthérapie Edit. Haug
<b>111623 LIPLEU01-FR</b>	P.F. de LEUZE De l'aiguille au coeur de mes patients Edit. Les 2 encres
<b>112972 LIPMPV02-FR</b>	P. MAGNIN P. VIDAL P. BECU De la Chromothérapie à la médecine photonique

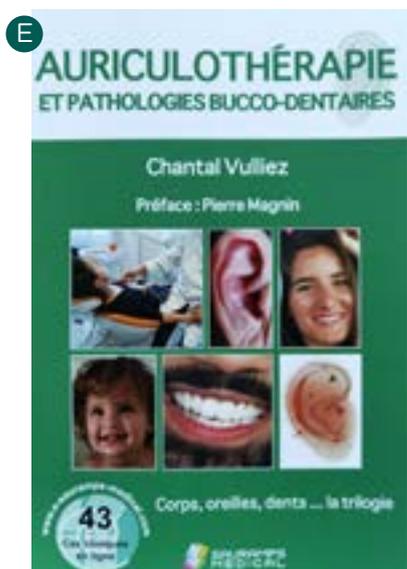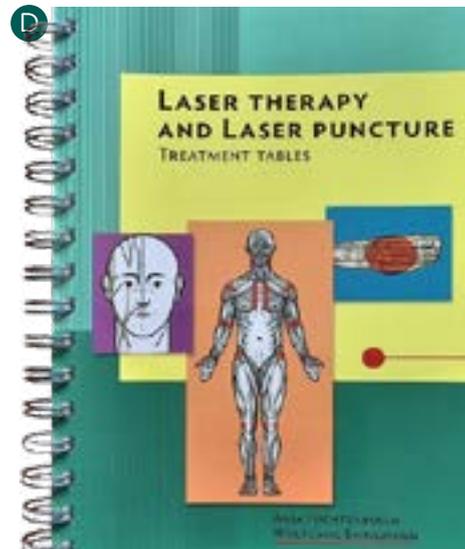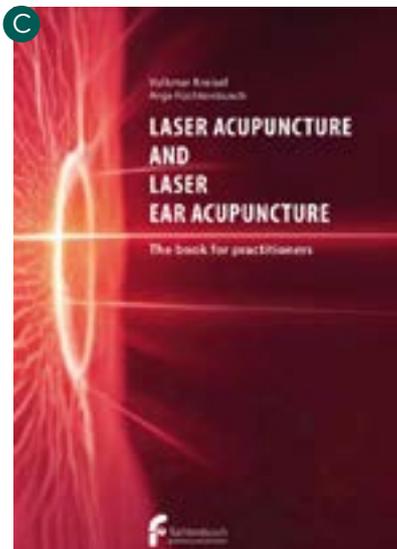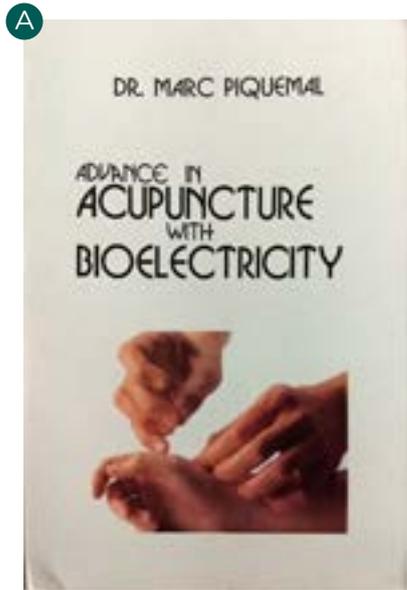

# BÜCHER

## VETERINÄR (AUF ENGLISCH)

<b>A 113461 LIAFPR01-AN</b>	A. FUECHTENBUSCH and Peter Rosin "Laser Therapy and Acupuncture on Horses"
<b>B 113462 LIAFPR02-AN</b>	A. FUECHTENBUSCH and Peter Rosin "Laser Therapy and Laser Puncture in Dogs and Cats"

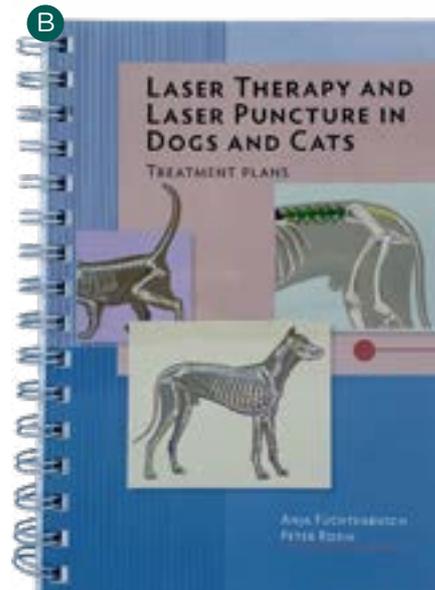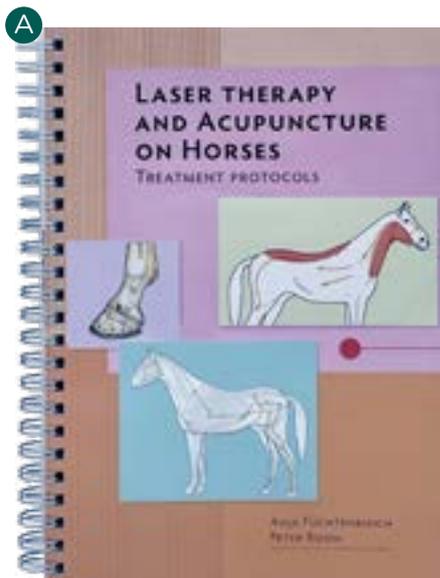




# VON DER FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG ÜBER DIE FERTIGUNG BIS HIN ZUM ENTWURF UND DER ENTWICKLUNG IST ALLES «MADE IN FRANCE»

## HERSTELLUNG DER NADELN

Das Herzstück von Sedatelec sind die Reinräume für die Produktion von ASP®-Dauernadeln. Ausgestattet mit modernen Maschinen, die Teile mit einer Genauigkeit von einem hundertstel Millimeter produzieren, reduziert dieser automatisierte Prozess unnötiges Handling. Die von den Normen vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen gewährleisten eine optimale Sauberkeit der Nadeln vor ihrer Sterilisation mit Gammastrahlen. Zusätzlich werden alle Nadeln vor dem Verpacken einer 100%igen Endkontrolle mittels optischer Kamera unterzogen.

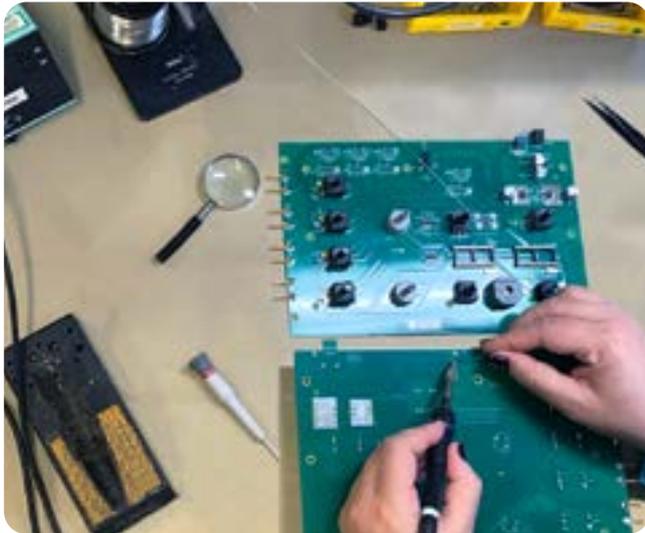

## WERKSTATT FÜR DIE ELEKTRONIKFERTIGUNG

Von der Forschung und Entwicklung über die Fertigung bis hin zum Entwurf und der Entwicklung ist alles **«Made in France»**.

Das computergestützte Produktionsmanagement garantiert eine perfekte Rückverfolgbarkeit aller Teile. Jeder Schritt der von erfahrenen Fachleuten durchgeführten manuellen Montage wird kontinuierlich überwacht. Modernste elektronische Anlagen prüfen jedes Gerät vor der Auslieferung und gewährleisten so eine optimale Qualität.



# INDEX

Adapter Premio - EU	20
Adapter Premio - UK	20
Adapter Premio - US	20
Agistim Duo	16
Agistim Duo Testeinheit	16
Agistim Duo Kit lipolyse	16
Agistim Duo Nadelstecker Weiß	16
Anzeiger Anti-Tabak-Behandlung	35
ASP® Original Classic	8
ASP® Original Gold	8
ASP® Original Titanium	8
ASP® Perma	11
Bildtafeln	42
Bücher	44
EASYO 5 - Detektor 3V	41
EASYO 3 - Detektor schwarz-weiss, kurz	41
EASYO 2 - Detektor schwarz-weiss, lang	41
EASYO 4 - Detektor Nord-Süd	41
EASYO 7 - Detektor Gold-Silber	41
EASYO 8 - Detektor Triple Bahr	41
Disk D3 - Premio 40	38
Disk D4 - Premio 40	38
Disk GIR - Premio 40	38
Disk PCF - Premio 40	38
Disk Blank - Premio 40	38
DMAT Elektroden für die Patienten-Erdung	35
DMAT Patienten-Erdungsvorrichtung	35
Drucktaster 130G Schwarz	34
Drucktaster 250G Blau	34
Drucktaster 400G Orange	34
Drucktaster 650G Beige	34
Farbfrequenzprogramm LEE	38
Filter Aufbewahrungsschachtel	41
Filterbrillenhalter	40
Filter 1 farbe	37
Filter 1L farbe	36
Filter: 2 Farben übereinanderliegend	39
Filter: 3 Farben stern	39
Filter: 3 Farben übereinanderliegend	39
Filter: Gold	40
Filter: Magnetisch	40
Filter: Magnetisch gepolt	40

Filter: Magnetisch Nord-Süd	40
Filter: Magnetisch Nord-Süd gepolt	40
Filter: Polaroid	40
Filter: Polaroid gekreuzt	40
Filter: Raum-Zeit	40
Filter: Schwarz/weiß	40
Filter: Schwarz/weiß gepolt	40
Filter: Silber	40
Filter: Tonerde (Argile)	40
Glasstäbe	34
Gummi-Leerfilter	40
Holster für die Premio laser	20
Klebeplaster ASP®	10
Leerfilter Anotest	40
Multi-Drucktaster	34
Nadelstecker Weiß	16
Ohrstempel Holz	35
Ohrstempel Selbstfärbend	35
Premio 10 Moxa	32
Premio 10 Moxa Konzentrator	32
Premio 20 D	14
Premio 20 DT	14
Premio 20 DT VET	14
Premio 30 Evo Laser Duo	20
Premio 32 Evo Laser A-G program	23
Premio 32 D Laser	25
Premio 32 V Evo	24
Premio 40 Light	28
Premio Ständer	20
Silikon-Ohr Rechtes	35
Silikon-Ohr Linkes	35
Stift: Flexibler	41
Stift: Halbstarrer	41
Styl modul	16
Verstärkte Stahlaufsätze Premio 32 Vet	24
Wattestäbchen	41
Winkelmesser 30°	35

# SALE CONDITIONS

This price-list applies to medical devices distributors who have an agreement with Sedatelec, and includes traceability of the product once sold. All prices are shown ex.tax and are valid until 31/12/2021 for all countries which recognise the CE mark and Canada. Only the ASP® Original, auriculomedicine instruments (feelers, ears, etc.) and the Premio 10 moxa and Premio 40 light are available in the United States.

Prices exclude carriage and may be subject to minimum order amounts. Please contact your representative.

## GUARANTEE

Our devices are guaranteed for 2 years parts and labour against any manufacturing defect except for parts subject to wear (cables, probes, batteries etc.), for use in accordance with the user guide. This guarantee does not cover in particular damage due to dropping or crushing, emersion in or spillage of liquids or leakage of batteries into the boxes. Small parts are guaranteed for 1 year.

## TRANSFER OF OWNERSHIP

The merchandise supplied will remain the property of Sedatelec until full payment has been received.

## ASSIGNEMENT

In the event of dispute, the Lyon Commercial Court is the only competent authority.

## SHIPMENT

- **Europe:** Carriage paid for shipments over 4.000 € Ex.Tax, except for express delivery.
- **Major export:** Invoiced at cost.

## PAYMENT

Order should be paid for prior to dispatch/Proforma quotations and invoices are available on request.

### Bank transfer:

<b>BNP PARIBAS</b>		
Agence AER Lyon Metropole E		
<b>N° de compte:</b> 00024094070		
<b>Banque:</b> 30004	<b>Guichet:</b> 00694	<b>Clé :</b> 79
<b>IBAN:</b> FR76 3000 4006 9400 0240 9407 079		
<b>BIC:</b> BNPAFRPPXXX		

<b>HSBC</b>		
BBC LIVE		
<b>N° de compte:</b> 01782009895		
<b>Banque:</b> 30056	<b>Guichet:</b> 00178	<b>Clé :</b> 22
<b>IBAN:</b> FR76 3005 6001 7801 7820 0989 522		
<b>BIC:</b> CCFRFRPPXXX		

- Bank cards:   
- Bank cheque
- Bank transfer of documents (bank details to be provided)

Payment should be made at retail cost as described in our pricing terms. Pursuant to legislation in force on 1st January 2013, any delay in settlement will result in an immediate late payment charge calculated on the basis of 3 times the current interest rate at the time and a single recovery costs payment of 40 € (Article L 446-6 of the French Commercial Code).

In the event of non-payment the supplier reserves the right to suspend or cancel ongoing orders without prejudice and all outstanding amounts due will be demanded immediately.

## CLINICAL FOLLOW-UP

In the framework of the new European Regulation on Medical Devices, we are required to reinforce the monitoring and analysis of our products after they are brought to market. This provides us with a superb opportunity to learn more about “unconventional” therapeutic methods, while demonstrating the effectiveness and complete safety of our products.

To do this, we need your help to expand our clinical files.

Please take a few minutes to answer this (these) questionnaire(s), which we need in order to continue our activity.

Rest assured that we are still committed to providing you with the best.



Chemin des Mûriers • F-69540 Irigny (Lyon) France

**Tel:** +33 (0) 472 663 322 • **Fax:** +33 (0) 478 508 903 3

[contact@sedatelec.com](mailto:contact@sedatelec.com) • [www.sedatelec.com](http://www.sedatelec.com)

### FOLGEN SIE UNS:



[Sedatelec International](#)



[Sedatelec](#)



Chemin des Mûriers • F-69540 Irigny (Lyon) France  
**Tel:** +33 (0) 472 663 322 • **Fax:** +33 (0) 478 508 903 3  
[contact@sedatelec.com](mailto:contact@sedatelec.com) • [www.sedatelec.com](http://www.sedatelec.com)